



**UNCA**





## “PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA”

Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 0121-2022/CO-UNCA, de  
fecha, 23 de marzo de 2022



**MARZO, 2022  
HUAMACHUCO**

*¡La Universidad del Ande Liberteño!*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA</b>	FECHA:	Marzo - 2022	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>2 DE 75</b>	

# COMISIÓN ORGANIZADORA

## PRESIDENTE

**DR. RUBÉN DARÍO MANTURANO PÉREZ**

## VICEPRESIDENTE ACADÉMICO

**DRA. MARGARITA ISABEL HUAMÁN ALBITES**



## VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN

**DR. ÍTALO WILE ALEJOS PATIÑO**



*Jan Villegas*

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
UN VERSIDAD NACIONAL <b>CIRO ALEGRÍA</b> HUAMACHUCO  <b>Blgo. Luis Alberto Villegas Sánchez</b> <small>ASISTENTE DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA</small>	UNIVERSIDAD NACIONAL <b>CIRO ALEGRÍA</b> HUAMACHUCO  <b>Ms. Judith Marigen Bocanegra Núñez</b> <small>PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, QUÍMICA Y FÍSICA</small>	UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA COMISIÓN ORGANIZADORA  <b>Dr. RUBÉN DARÍO MANTURANO PÉREZ</b> PRESIDENTE
<b>BLGO. LUIS VILLEGAS SÁNCHEZ</b>	<b>COMITÉ DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, QUÍMICA Y FÍSICA</b>	<b>COMISIÓN ORGANIZADORA</b>
<b>01/02/2022</b>	<b>01/03/2022</b>	<b>23/03/2022</b>



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>3 DE 75</b>	

## CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	OBJETIVOS	4
III.	ALCANCE	5
IV.	BASE LEGAL	5
V.	RESPONSABILIDADES	6
VI.	DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS	11
VII.	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	14
VIII.	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS)	15
IX.	PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES	16
X.	NORMAS DE SEGURIDAD.	26
XI.	SIGNOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD	29
XII.	SEÑALES DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN	33
XIII.	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	37
XIV.	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	43
XV.	MANEJO DE SUSTANCIAS	53
XVI.	ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	58
XVII.	INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD	59
XVIII.	CONTACTOS DE EMERGENCIA	60
XIX.	CONTROL DE CAMBIOS	60
XX.	ANEXOS	61



*Handwritten signature*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>4 DE 75</b>	

## I. INTRODUCCIÓN

El Laboratorio de Biología (en adelante Laboratorio), es un espacio que cuenta con las herramientas, equipos y personal profesional necesario para desarrollar prácticas y experimentos necesarios para el crecimiento y competencia profesional de sus estudiantes. Sin embargo, este espacio está propenso a una serie de riesgos de origen y consecuencias muy variadas, desde los errores humanos y de fallas propias del equipamiento, mobiliario, infraestructura física, hasta técnicas de laboratorio incorrectas y mal uso de herramientas y equipos, que podrían ser la causa de muchos accidentes en el laboratorio.

En este sentido, la Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA), bajo los principios de prevención, gestión integral, participación, responsabilidad y atención integral de la salud de los docentes, personal no docente, estudiantes y egresados los cuales constituyen la base de la política de seguridad y salud en el trabajo; formula el presente documento con la finalidad de guiar la ejecución de las sesiones de aprendizaje práctico en el Laboratorio, haciendo uso de los equipos y materiales tomando en cuenta las precauciones y procedimientos mínimos que se requieren para evitar o minimizar riesgos y accidentes más comunes; haciendo hincapié en el uso de prácticas correctas, el equipo de contención apropiado, el diseño, la operación y el mantenimiento de las instalaciones, y los aspectos administrativos necesarios para reducir al mínimo el riesgo de lesiones o enfermedades entre los usuarios del laboratorio.





## II. OBJETIVOS

### 2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer las normas y estándares de seguridad para el desempeño eficiente y seguro de las actividades desarrolladas al interior del Laboratorio de Biología, minimizando la ocurrencia de accidentes o riesgos a la salud a usuarios de dicha área.

### 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 2.2.1. Establecer los procedimientos de seguridad, y protección personal y colectiva adecuadas para el laboratorio.
- 2.2.2. Comunicar a los usuarios las responsabilidades, peligros, riesgos, medidas de protección y reglas básicas de seguridad en el Laboratorio.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>5 DE 75</b>	

### III. ALCANCE



El presente protocolo es de cumplimiento obligatorio para el personal docente, no docente, estudiantes y egresados que hagan uso del Laboratorio de Biología.

### IV. BASE LEGAL

- 4.1. Constitución Política del Perú.
- 4.2. Ley N°30220, Ley Universitaria.
- 4.3. Ley N°29756, que crea la Universidad Nacional Ciro Alegría.
- 4.4. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
- 4.5. Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222
- 4.6. Decreto Legislativo N°1278 “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.
- 4.7. Decreto Supremo N°001-2012-MINAM “Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”.
- 4.8. Decreto Supremo N°021-2008-MTC “Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”.
- 4.9. Decreto Supremo N°015- 2005-S.A. Reglamento sobre Valores Límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de Trabajo.
- 4.10. Decreto Supremo N°003-98-S.A. del 14.04.08- Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- 4.11. Resolución Ministerial N°200-2015-MINAM “Aprueban Disposiciones Complementarias al Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”.
- 4.12. Resolución Ministerial N°375.2008-TR. Normas básicas de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos.
- 4.13. Norma Técnica Peruana 900.058-2019: Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos.
- 4.14. Norma Técnica Peruana 900.066-1-2016: Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE. Parte 1: Tratamiento de RAEE con monitores y pantallas.
- 4.15. Norma Técnica Peruana 900.064-2012: Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generalidades.
- 4.16. Norma Técnica Peruana 900.065-2012: Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.



*Handwritten signature*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>6 DE 75</b>	

Generación, recolección interna, clasificación y almacenamiento. Centros de acopio.

4.17. Norma NFPA 704.

4.18. Estatuto de la Universidad Nacional Ciro Alegría.

4.19. Reglamento General de la Universidad Nacional Ciro Alegría.

## V. RESPONSABILIDADES

### 4.1. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1.1. Coordinar las capacitaciones al personal docente, administrativo, estudiantes y usuarios externos en temas de seguridad para salvaguardar su integridad en la realización de sus actividades en el laboratorio.

4.1.2. Monitorear la implementación, aplicación y cumplimiento del presente protocolo.

### 4.2. COMITÉ DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, QUÍMICA Y FÍSICA

4.2.1. Velar por la aplicación y cumplimiento del presente protocolo,

4.2.2. Elaborar, revisar, modificar y aprobar documentos específicos en materia de seguridad del laboratorio.

4.2.3. Realizar inspecciones de seguridad con el fin de salvaguardar la integridad del personal y las condiciones de los equipos, materiales e infraestructura del laboratorio.

4.2.4. Tener actualizados la lista de equipos y los registros de mantenimiento e inspecciones periódicas.

4.2.5. Participar en la investigación de incidentes o accidentes ocurridos dentro del laboratorio.

4.2.6. Participar en la elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos –IPERC del laboratorio.

4.2.7. Velar por la adecuada señalización de seguridad del laboratorio.

4.2.8. Capacitar al personal docente, administrativo, estudiantes y usuarios externos en temas de seguridad para salvaguardar su integridad en la realización de sus actividades en el laboratorio.



4.2.9. Asegurar el manejo adecuado de residuos de acuerdo a lo establecido en el protocolo y procedimientos desde su generación hasta su disposición final.

4.2.10. Verificar que el personal responsable del manejo de residuos use los equipos de protección personal adecuados y en buen estado.



*Jan*



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01		
	PÁGINA:	<b>7 DE 75</b>		

- 4.2.11. Verificar que la adquisición de insumos, materiales y equipos para el manejo de residuos y seguridad del laboratorio sean suficientes para satisfacer las necesidades.
- 4.2.12. Llevar el control de los residuos peligrosos y RAEE generados en el laboratorio.
- 4.2.13. Otras inherentes al cargo.

### 4.3. JEFE DEL LABORATORIO



- 4.3.1. Es responsable de la seguridad, verificando la implementación y uso de los estándares, de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), así como el cumplimiento de los reglamentos internos.
- 4.3.2. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Protocolo de Seguridad del Laboratorio de Biología en coordinación con los involucrados.
- 4.3.3. Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en condiciones inseguras que amenacen la integridad de las personas, equipos e instalaciones, hasta que se eliminen o mitiguen dichas amenazas.
- 4.3.4. Participar en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos – IPERC, del laboratorio.
- 4.3.5. Participar en la determinación de las especificaciones técnicas del mantenimiento de equipos y/o instalaciones, vigilando que cumplan con las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
- 4.3.6. Llevar el control y garantizar el estado y funcionamiento adecuados de los equipos de protección colectiva.
- 4.3.7. Informar y coordinar mensualmente al comité de seguridad biológica, química y física de la Universidad acerca de la gestión de la seguridad del laboratorio.



*Handwritten signature*

### 4.4. ASISTENTE DEL LABORATORIO

- 4.4.1. Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del Protocolo de Seguridad de Laboratorio de Biología y reglamentos internos de seguridad de la universidad.
- 4.4.2. Es responsable de compartir los protocolos de seguridad del laboratorio mediante charlas de inducción.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>8 DE 75</b>	

- 4.4.3. Ser responsable por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.
- 4.4.4. Reportar a su jefe inmediato cualquier incidente o accidente y participar de su investigación.
- 4.4.5. Realizar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos – IPERC, de su área de trabajo.
- 4.4.6. Realizar periódicamente inspecciones de seguridad del laboratorio.
- 4.4.7. Comprobar al inicio de cada práctica la disposición de los medios y equipos de seguridad adecuados y Realizar la inspección diaria de seguridad del laboratorio (Ver Anexo N° 1)
- 4.4.8. Iniciar el procedimiento de solicitud de reemplazo de los elementos de protección y equipos de protección cuando estos lleguen al final de su vida útil, acudiendo a la dependencia encargada de seguridad y salud en el trabajo de la universidad.
- 4.4.9. Realizar el requerimiento de elementos faltantes en relación al área de seguridad al jefe inmediato, el mismo que será derivado al área correspondiente.
- 4.4.10. Participar obligatoriamente en toda capacitación programada alineada al laboratorio y otras inherentes al cargo.
- 4.4.11. Otras inherentes al cargo.

#### 4.5. USUARIOS DE LABORATORIOS



Los usuarios son las personas que utilizan el Laboratorio de Biología y comprenden:

- 4.5.1. Usuario interno: Es el personal docente y no docente, estudiantes y egresados, cuyas responsabilidades como usuarios se establecen de la siguiente manera:

##### a. Docentes:

- a.1. Cumplir con los estándares de seguridad establecidos dentro del protocolo y recomendaciones proporcionadas por el jefe de laboratorio o asistente de laboratorio.
- a.2. Transmitir a los estudiantes los conocimientos, estándares de seguridad y puntos importantes de este protocolo para orientar en el desarrollo de un trabajo seguro en el laboratorio.



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>9 DE 75</b>	



- a.3. Informar a los estudiantes sobre los riesgos y peligrosidad de sustancias, experimentos, entre otros.
- a.4. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en este documento cualquiera sea la finalidad del uso de laboratorio, inclusive durante las visitas guiadas.
- a.5. Exigir el uso de equipos de protección personal necesarios.
- a.6. Dirigir las actuaciones en caso de accidente y emergencia, siguiendo las indicaciones correspondientes al protocolo.
- a.7. Velar por el uso adecuado de los equipos e instalaciones del laboratorio.
- a.8. Mantener el orden y limpieza del laboratorio en todo momento del desarrollo de la práctica.
- a.9. Gestionar los residuos peligrosos conforme al protocolo.
- a.10. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes.
- a.11. Alcanzar la guía de práctica que oriente al desarrollo de un trabajo seguro en el laboratorio, tanto al asistente de laboratorio como a los estudiantes, una semana antes de realizarse la práctica.

**b. Estudiantes y egresados:**

- b.1. Atender y acatar las indicaciones, recomendaciones y normas de seguridad, relacionada al uso de equipos de protección personal, prevención de riesgos y gestión de residuos.
- b.2. Familiarizarse con la localización y uso de los equipos de seguridad, así como con la señalética de seguridad (salidas de emergencia, zonas de seguridad, entre otros).
- b.3. No manipular equipos ni realizar experimentos que no estén autorizados ni monitoreados por el docente o algún responsable del laboratorio.
- b.4. Usar los equipos de protección personal exclusivamente dentro del laboratorio.
- b.5. Mantener en todo momento el orden, limpieza y disciplina dentro y fuera del laboratorio.

**c. Personal no docente:**

- c.1. Conocer y cumplir lo establecido en el presente protocolo.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>10 DE 75</b>	



- c.2. Atender y acatar las indicaciones de seguridad del personal a cargo del laboratorio.
- c.3. Mantener en todo momento el orden, limpieza y disciplina dentro y fuera del laboratorio.

4.5.2. Usuario externo: Visitante que no forma parte de la universidad y que requiere el uso Laboratorio de Biología; cuyas responsabilidades son las siguientes:

- a. No ingresar al laboratorio sin haber recibido la inducción respectiva.
- b. Atender y acatar las indicaciones de seguridad del personal a cargo del laboratorio.
- c. Cumplir estrictamente las normas de seguridad establecidas en el presente protocolo.
- d. Mantener en todo momento el orden, limpieza y disciplina dentro y fuera del laboratorio.

## VI. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS



- a. **Accidente de trabajo:** Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
- b. **Almacenamiento:** Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.
- c. **Condición insegura:** Estado o situación de un ambiente que no brinda seguridad (es un peligro) y que puede ocasionar un riesgo o daño el cual puede causar accidente o enfermedad.
- d. **Contenedor primario:** Recipiente que entrega el proveedor con la sustancia química.
- e. **Derrame:** Fuga, descarga o emisión, producida por práctica o manipulación inadecuada de sustancias peligrosas.
- f. **Disposición final:** Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>11 DE 75</b>	

- g. **Enfermedad:** Condición física o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
- h. **Equipo de protección personal (EPP):** Todo elemento fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.
- i. **Evacuación:** Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se ha declarado una emergencia.
- j. **Extintor:** Equipo con propiedades físicas y químicas diseñado para la extinción inmediata del fuego.
- k. **Factor de riesgo:** Existencia de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que pueden producir lesiones o daños.
- l. **Fuego:** Proceso de combustión cuyos elementos indispensables son calor, combustible y oxígeno. Puede ser de tipo A (combustibles sólidos: madera, papel, plástico, etc.), B (combustibles líquidos: solventes, papel, plástico, etc.) y C (provenientes de equipos eléctricos); entre otros.
- m. **Fuente de riesgo:** Condición/acción que genera riesgo.
- n. **Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS):** Documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad.
- o. **Incompatibilidad:** Es el proceso que sufren las mercancías peligrosas cuando, puestas en contacto entre sí, puedan sufrir alteraciones de las características físicas o químicas originales de cualquiera de ellos con riesgo de provocar explosión, desprendimiento de llamas o calor, formación de compuestos, mezclas, vapores o gases peligrosos, entre otros.
- p. **Incendio:** Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas a las instalaciones y al medio ambiente.
- q. **Material biocontaminado:** Son aquellos materiales, instrumentos, equipos o sus partes, o residuos que están contaminados con agentes infecciosos o que contienen alta concentración de microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto directo con dichos materiales.
- r. **Neutralizar:** Hacer que una sustancia química sea neutra, que pierda su carácter ácido o básico.
- s. **Peligro:** Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de éstas.





*Handwritten signature*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>12 DE 75</b>	

- t. **Prevención:** Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.
- u. **Producto químico:** Designa los elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos.
- v. **Reactivos:** Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos, tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente, colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente.
- w. **Reanimación cardiopulmonar (RCP):** Técnica o maniobra de emergencia. Consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales.
- x. **Residuo o desecho:** Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
- y. **Residuos no peligrosos:** Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad que no presentan ningún riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.
- z. **Residuos peligrosos:** Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características infecciosas, combustibles, inflamables, explosivos, reactivas, radioactivas, volátiles, corrosivas y tóxicas, que puede causar daño a la salud humana y al medio ambiente. Así mismo, se consideran peligrosos los envases en paquetes y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
- aa. **Riesgo:** Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o explosión y la severidad de la lesión o enfermedad que pueden ser causados por evento o explosión.
- bb. **Sustancia biocontaminante:** Son aquellas muestras biológicas tales como orina, saliva, esputo, sangre, tejidos u otras secreciones o restos de humanos, animales, plantas o microorganismos, con potencial infeccioso, patógeno o



*Handwritten signature*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>13 DE 75</b>	

generador de toxinas capaces de originar o favorecer el desarrollo de enfermedades.

- cc. **Trasvase:** Procedimiento de pasar un líquido de un recipiente a otro.
- dd. **Cabinas de bioseguridad:** Recinto o espacio de trabajo cerrado y ventilado para mantener un área, libre de partículas o de probables contaminantes que puedan alterar el producto o el proceso con el cual se trabaja, afectar la salud del trabajador operario, o dañar el medio ambiente.
- ee. **Material infeccioso:** El material o sustancia infecciosa son aquellos respecto de las cuales se sabe, o se cree, que contienen agentes patógenos, entendiendo estos como microorganismos (bacterias, virus, parásitos, hongos, entre otros) y otros agentes, tales como priones, que pueden causar enfermedades en los animales o en los seres humanos.



## VII. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

La identificación de peligros y evaluación de riesgos se ha realizado en base al Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (PDI-PR-02).

A continuación, se presentan los peligros identificados en cada actividad, y sus respectivos riesgos:

**Cuadro N°01: Peligros y riesgos presentes en cada actividad desarrollada en el laboratorio**

TIPO DE PELIGRO	PELIGRO	RIESGO	ACTIVIDAD RELACIONADA
<b>BIOLÓGICO</b>	Sustancias biocontaminantes	Contacto de piel o mucosas con sustancias biocontaminantes	Uso de centrifuga/Uso de pipetas y micropipetas/uso de incubadoras/uso del autoclave
	Materiales biocontaminados	Contacto de piel o mucosas con sustancias biocontaminantes	Uso de cabina de flujo laminar/uso de micrótopo de mano
	Material o sustancia biológica	Exposición o contacto con materiales o sustancias biológicas desconocidas.	Uso de microscopio y estereoscopio
	Movimiento repetitivo	Sobre esfuerzo de miembros superiores	
<b>ELÉCTRICO</b>	Manipulación de interruptores con manos y pies mojados	Electrocución	Uso de equipos/uso de luminarias, accesorios e instalaciones
	Generación de chispas eléctricas		

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA</b>	FECHA:	Marzo - 2022	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>14 DE 75</b>	

	Sobrecarga de tomacorrientes y/o extensiones eléctricas	Generación de chispas eléctricas	
	Contacto con puntos energizados	Electrocución	
<b>LOCATIVO</b>	Mal estado de cables, interruptores o conexiones	Electrocución. Generación de chispas eléctricas	Uso de equipos/uso de luminarias, accesorios e instalaciones
	Accesorios eléctricos en mal estado	Electrocución. Generación de chispas eléctricas	
	Mobiliario inadecuado (superficies irregulares o inestables)	Caida de equipos	
	Piso resbaladizo y/o con obstáculos	Resbalones o caídas a nivel	
<b>QUÍMICO</b>	Envases o tapas en mal estado	Sobree Exposición a agentes tóxicos, irritantes o corrosivos	Manipulación de reactivos químicos/uso de pHmetro/uso de ducha-lavaojos/uso de pipetas
	Generación de vapores tóxicos	Inhalación de sustancias químicas	
	Contacto con sustancias tóxicas, corrosivas o irritantes	Contacto con piel, ojos, u otros, con sustancias corrosivas, irritantes, tóxicos.	
	Manipulación inadecuada de reactivos químicos	Contacto con piel, ojos, u otros, con sustancias corrosivas, irritantes, tóxicos.	
	Envases no rotulados	Sobree Exposición a agentes tóxicos, irritantes o corrosivos	
<b>FÍSICO</b>	Iluminación inadecuada del ambiente	Ambiente con poca iluminación o exposición a altas temperaturas	Uso del material del laboratorio/uso del autoclave/uso de centrifuga/uso de micrótopo
	Material particulado	Sobree Exposición a partículas sólidas en suspensión	
	Superficies calientes	Contacto con superficies a altas temperaturas	
	Sustancias calientes	derrames, salpicaduras y contacto con sustancias a altas temperaturas	
	Alta presión	Impacto de vapores calientes en rostro o manos	
	Radiación UV	Sobree Exposición a radiación UV	
<b>MECÁNICO</b>	Superficies filosas	Contacto del filo de la cuchilla con la piel, mano u otras partes del cuerpo	Uso de centrifuga/uso de micrótopo
	Generación de proyectiles	Impacto de proyectiles con ojos, rostro u otras partes del cuerpo	
	Rotor mal sujetado	Impacto de proyectiles con ojos, rostro u otras partes del cuerpo	





*Janet*

## VIII. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS)

Estos procedimientos son redactados como guía para tareas que presenten niveles de riesgo intolerable según la matriz IPERC correspondiente. A continuación, se enlista los procedimientos existentes en el Laboratorio de Biología y se adjuntan los PETS completos en el anexo 04:

*La impresión o copia adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"*



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>15 DE 75</b>	

- a. PETS para uso de centrífuga
- b. PETS para uso de Autoclave
- c. PETS para uso de micrótopo de mano
- d. PETS para uso del sistema de gas
- e. PETS para uso de sistemas eléctricos y luminarias
- f. PETS para uso de reactivos químicos
- g. PETS para uso de cocinilla eléctrica

## IX. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES

Ya que un accidente se produce de forma brusca e inesperada, sería conveniente que todos estén formados y entrenados para que en caso de accidente puedan socorrer al accidentado lo más rápida y eficazmente posible, activando cuanto antes el sistema de emergencia, para después actuar sobre el accidentado con el fin de no agravar las lesiones ya existentes que pudieran dejarle secuelas irreversibles, e incluso pudiendo salvarle la vida.

Así mismo. antes de realizar alguna actividad dentro de cualquiera de las instalaciones de la UNCA, se deben tener conocimiento de los siguientes puntos correspondientes a emergencias generales:



- a. Conocer los peligros a los que está expuesto en dicho ambiente y actividad.
- b. Conocer los procedimientos existentes referentes a la actividad a realizar.
- c. Tener pleno conocimiento de los canales de emergencia y del procedimiento de comunicación.
- d. Conocer e identificar todas las salidas de emergencia, lavaderos y ducha-lavaojos, extintores, mantas ignífugas, equipos de respuesta ante derrames, válvulas de cierre de emergencia, zonas de seguridad, botiquín, etc.)

### 9.1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES POR ELECTROCUCIÓN

El peligro de una descarga eléctrica es de suma importancia, esta puede causar quemaduras o puede no dejar ninguna marca visible en el cuerpo. En cualquier caso, si una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede causar daños internos, un paro cardíaco u otras lesiones. En determinadas circunstancias, incluso una pequeña cantidad de electricidad puede ser mortal. Este hecho justifica que se preste una atención especial a la atención de este tipo de accidentes.

*La impresión o copia adquiere el estado de **"DOCUMENTO NO CONTROLADO"***



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>16 DE 75</b>	

### 9.1.1 ANTES



- a.1. Inducciones a responsables de laboratorio, docentes y estudiantes sobre peligros riesgos, controles y procedimientos de uso de sistemas eléctricos.
- a.2. Contar con todos los EPPs indicados en los procedimientos o por los docentes (gafas, mascarillas, batas, guantes, o material aislante).
- a.3. Conocer la ubicación del botiquín de primeros auxilios.
- a.4. Existencia de un sistema de comunicación para notificación rápida de ocurrencia de accidentes; y conocimiento por parte de los usuarios.

### 9.1.2 DURANTE

- b.1. Comunicar de forma inmediata la ocurrencia de accidente, al responsable del laboratorio o algún brigadista de emergencia.
- b.2. Antes de tocar al accidentado se debe cortar la corriente. Cuando no sea posible desconectar la corriente para separar al accidentado, el socorrista deberá protegerse utilizando materiales aislantes, tales como madera, goma, etc. (Coger al accidentado por la ropa; evitar cogerle por la mano u otra zona corporal).
- b.3. Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del accidentado al cortar la corriente, poniendo mantas, abrigos, almohadas, etc. para disminuir el efecto traumático.
- b.4. Si la ropa del accidentado ardiera, se apagaría mediante sofocación (echando encima mantas, prendas de lana, ... nunca acrílicas), o bien le haríamos rodar por la superficie en que se encontrase. Nunca utilizar agua.
- b.5. Evaluar los signos vitales en este orden: Conciencia, respiración y pulso.
- b.6. Si la respiración o pulso se han detenido, realizar las técnicas de reanimación cardiopulmonar (R.C.P.) Hasta la recuperación del accidentado o la llegada del equipo profesional.
- b.7. Evitar que el lesionado se enfríe.
- b.8. Una vez hecho el control de signos vitales, realizar la valoración secundaria, consistente en evaluar las heridas, quemaduras, fracturas y hemorragias procurando no agravarlas y mantenerlas en el mejor estado posible hasta la llegada del equipo profesional.



*Jan*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>17 DE 75</b>	

- b.9. Coloca una venda. Tapa todas las zonas quemadas con una venda de gasa estéril (si se puede conseguir) o con una tela limpia.
- b.10. Si fuera accidente con alto voltaje: No acercarse a los cables de alto voltaje hasta que se corte el suministro eléctrico. Los tendidos eléctricos generalmente no están protegidos con aislación. Mantenerse al menos a 6 metros de distancia o más si los cables se sacuden y emiten chispas.

### 9.1.3 DESPUÉS



- c.1. Reportar el accidente ocurrido.
- c.2. Las lesiones por electricidad pueden manifestarse de forma súbita, inmediata a la electrocución o bien pueden aparecer pasadas unas horas del accidente. Por tanto, se deberá vigilar constantemente al accidentado.
- c.3. Hacer seguimiento a la salud de las personas afectadas, según indique el personal de tóxico o algún médico a cargo.

## 9.2. PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTES DE CORTES O HERIDAS PUNZANTES

Las heridas (raspones, cortes, laceraciones, lesiones punzantes, etc.) se encuentran entre los accidentes más frecuentes durante la manipulación de material e instrumentos de metal o de vidrio, y acarrear dos riesgos que es necesario evitar para que no pasen a mayores: la hemorragia (conlleva al estado de shock) y la infección; por lo que es necesario conocer las pautas mínimas de cómo reaccionar ante ellas.

### 9.2.1 ANTES

- a.1. Inducciones a responsables de laboratorio, docentes y estudiantes sobre peligros riesgos y controles en la manipulación de material o instrumentos de vidrio, metal y punzocortantes.
- a.2. Contar con todos los EPPs indicados en los procedimientos o indicados por los procedimientos y docentes (gafas, mascarillas, batas, guantes, así como material de bioseguridad).
- a.3. Conocer la ubicación del botiquín de primeros auxilios.
- a.4. Existencia de un sistema de comunicación para notificación rápida de ocurrencia de accidentes; y conocimiento por parte de los usuarios.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BILOGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>18 DE 75</b>	

### 9.2.2 DURANTE



- b.1. Comunicar de forma inmediata la ocurrencia del accidente, al responsable del laboratorio, docente u algún miembro de brigada de emergencia.
- b.2. Para heridas leves: Lavarse bien las manos con agua y jabón y luego lavar la herida con agua y jabón.
- b.3. No utilice alcohol, u otro líquido (ocasionan que la herida tarde más en cicatrizar) cubrir la herida con una gasa estéril y fijarlas con esparadrapo.
- b.4. Si la herida tiene una extensión o profundidad considerable: no tratar de curarlas, solo colocar una compresa o una gasa estéril si hubiera hemorragia, y acudir al tópico o centro de salud. Aplicar la vacuna antitetánica si fuera necesario.
- b.5. Para heridas graves: Controlar la hemorragia, si la hubiese.
- b.6. No indagar en la herida, ni extraer cuerpos extraños, sujetarlos para evitar que se muevan.
- b.7. Colocar gasa húmeda estéril y realizar un vendaje improvisado y trasladar a tópico o centro de salud.
- b.8. Para control de hemorragias: Usando guantes aplique sobre la herida una gasa o tela limpia. La presión directa se puede sustituir por un vendaje. Cuando la herida pare de sangrar o si es demasiado grande, aplicar una compresa de hielo con presión directa por 10 minutos.
- b.9. Procurar la elevación de la parte lesionada (disminuye la presión de la sangre en el lugar de la herida) Si la herida está situada en el brazo o la pierna hay que levantar y presionar.
- b.10. No retirar nunca la primera gasa esterilizada.
- b.11. Llevar al lesionado al tópico o establecimiento de salud cercano.

### 9.2.3 DESPUÉS

- c.1. Desechar todo el material utilizado en desinfección de las lesiones.
- c.2. Limpiar y desinfectar las superficies u objetos que hayan tenido contacto con sustancias biológicos.
- c.3. Reportar el accidente ocurrido.
- c.4. Consultar si fuera necesario aplicar la vacuna antitetánica al lesionado.
- c.5. Hacer seguimiento a la salud de las personas afectadas, según indique el personal de tópico o algún médico a cargo.



*Jan*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>19 DE 75</b>	

### 9.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES BIOLÓGICOS



El peligro biológico constituye uno de los principales riesgos que enfrentan los estudiantes y docentes en prácticas de materias en biología. Por tal motivo resulta apremiante dar a conocer las precauciones específicas tendientes a minimizar al máximo la posibilidad de contagiarse o verse afectado por patologías infecto-contagiosas. Se consideran accidentes biológicos la ocurrencia de contacto con sustancias biocontaminantes o materiales biocontaminados; a través de contacto directo con piel o mucosas, inhalación, inoculación percutánea (pinchazo o corte) o contacto con herida abierta, entre otros; que pueden provocar efectos negativos como procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos que afectan la salud de las personas expuestas.

#### 9.3.1 ANTES

- a.1. Inducciones a responsables de laboratorio, docentes y estudiantes sobre peligros biológicos y respuesta ante emergencias biológicas.
- a.2. Contar con EPPs adecuados y necesarios: gafas, mascarillas, batas, guantes, así como material de bioseguridad.
- a.3. Tener conocimiento de las sustancias biológicas con las que se trabajarán, así como los cuidados que se deben considerar.
- a.4. Evaluar la consideración de realizar las actividades utilizando cámara de flujo laminar.
- a.5. Existencia de un sistema de comunicación para notificación rápida de ocurrencia de accidentes; y conocimiento por parte de los usuarios.

#### 9.3.2 DURANTE

- b.1. Comunicar de forma inmediata la ocurrencia de accidente con material o sustancias con potencial biocontaminante, al responsable del laboratorio.
- b.2. Si ocurrieran salpicaduras o contacto de sustancias biocontaminantes sobre la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón germicida, y no frotar para no causar laceración.
- b.3. Si ocurrieran salpicaduras de sustancias biocontaminantes sobre ojos u otras mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- b.4. Salpicaduras o exposición en boca, enjuagar la boca con abundante agua y escupir; evitar producir laceraciones, no utilice hipoclorito de sodio.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>20 DE 75</b>	

- b.5. Ante ocurrencia de pinchazos o heridas con material punzocortante, deje sangrar libremente (no presione), y lavar con abundante agua y jabón, no frote, ni utilice soluciones como hipoclorito de sodio.
- b.6. Para contacto de heridas con sustancias biocontaminantes, lavar con agua y jabón, facilitando el sangrado, desinfectar la herida con un antiséptico y cubrir con apósito impermeable.
- b.7. En caso de derrame: Usar guantes, cubrir el derrame con tela o papel absorbente, verter desinfectante y parar las actividades por lo menos 30 min. Y señalizar
- b.8. Retirar todo el material de limpieza, así como fragmentos de vidrio si lo hubiesen.
- b.9. Limpiar las superficies o áreas contaminadas y desinfectar con alcohol al 70%.

### 9.3.3 DESPUÉS

- c.1. Desechar todo el material utilizado en la limpieza y desinfección en los contenedores de residuos peligrosos.
- c.2. Desinfectar el material en autoclave o mantenerlo sumergido en desinfectante (hipoclorito al 1% o alcohol al 70% durante al menos 24 horas).
- c.3. Reportar el accidente ocurrido.
- c.4. Hacer seguimiento a la salud de las personas afectadas, según indique el personal de tóxico o algún médico a cargo.



## 9.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES QUÍMICOS

En el caso de emergencias con productos químicos (cianuro de sodio, oxido de calcio, ácido sulfúrico, peróxido de hidrogeno, gas licuado de petróleo, combustibles y lubricantes, hidróxido de sodio, ácido nítrico, mercurio, cloro, etc.), tales como derrames, fugas de diversas magnitudes el objetivo principal es la pronta respuesta y evitar en forma rápida la dispersión de estos productos.

### 9.4.1 ANTES

- a.1. Revisión periódica de zonas de almacenamiento de productos químicos.



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>21 DE 75</b>	



- a.2. Capacitación al personal en respuesta a emergencias con productos químicos.
- a.3. Capacitación de hoja de datos de seguridad de materiales (hoja MSDS) al personal que manipula productos químicos.
- a.4. Implementación de sistema de detección de gases en zonas de almacenamiento de productos químicos.
- a.5. Control y verificación de sistemas de lucha contra incendios.
- a.6. Existencia de un sistema de comunicación para notificación rápida de ocurrencia de accidentes; y conocimiento por parte de los usuarios.
- a.7. Implementación y control de sistema de respuesta para neutralización de derrame de sustancias químicas.
- a.8. Contar con paños absorbentes para atrapar los líquidos derramados, en las áreas de laboratorios y talleres.

9.4.2 DURANTE

- b.1. Comunicar de forma inmediata las ocurrencias de fugas o derrames de productos químicos al responsable del laboratorio o a la brigada MATPEL.
- b.2. La brigada, evaluará la situación, y adoptará las medidas convenientes de acuerdo al producto químico derramado.
- b.3. Neutralizar las sustancias ácidas o cáusticas.
- b.4. El personal entrenado podrá usar los productos químicos del lugar para neutralizarse entre sí (según las hojas MSDS).
- b.5. Usar paños absorbentes para contener los líquidos derramados.
- b.6. Se utilizarán de manera adecuada los equipos de protección personal para los integrantes que realicen las tareas de control de la fuga o derrame.
- b.7. En caso de salpicaduras a ojos u otras zonas corporales, es imprescindible irrigar o lavar con abundante agua o suero fisiológico durante al menos 15 minutos y seguir las recomendaciones de la hoja MSDS (en algunos casos puede no ser recomendado el uso de agua para el lavado).
- b.8. Si se provocan quemaduras al tocar algo caliente, se debe lavar con abundante cantidad agua fría, eliminar el calor, aplicar pomada para quemaduras que estará en el botiquín.



*Handwritten signature*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>22 DE 75</b>	

b.9. Para casos de ingestión, si la persona está consciente, provocar el vómito y seguir las recomendaciones de la hoja MSDS.

#### 9.4.3 DESPUÉS

c.1. Depositar los materiales utilizados en la contención del derrame (pañeros absorbentes y trapos) en un cilindro con la parte superior abierta y sellarlo para su eliminación. Hacer una retroalimentación sobre la manipulación de los productos químicos, transporte, almacenamiento, entre otras capacitaciones que se vean por conveniente.

### 9.5. PROCEDIMIENTO EN CASOS DE EMERGENCIA

Prevención para casos de emergencias:



- a. Deben estar conformadas todas las brigadas para cada tipo de emergencia y ser de conocimiento de los responsables de laboratorio, docentes y estudiantes.
- b. Responsables de laboratorio, docentes y estudiantes deben haber recibido, por lo menos, una inducción al año sobre respuesta ante emergencias.
- c. Los responsables de laboratorios y docentes deben participar en los simulacros de emergencia realizados por la UNCA.

#### 9.5.1 EMERGENCIA POR SISMOS:

En caso de sismo el objetivo es proteger la integridad física del personal docente, no docente, estudiantes y egresados, en la zona de seguridad y lugares debidamente preestablecidos para su ubicación temporal.

##### 9.5.1.1 ANTES DEL SISMO

- a.1. Se debe identificar y señalizar las zonas de seguridad interna, rutas de escape, salidas de emergencia y puntos de reunión.
- a.2. Dar a conocer a todo usuario que haga uso del laboratorio de biología, los procedimientos ante emergencias, planos de seguridad, la ubicación de las zonas internas de seguridad, rutas de escape, salidas de emergencia y puntos de reunión.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BILOGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>23 DE 75</b>	

a.3. Se debe inspeccionar periódicamente que los objetos ubicados en lugares elevados (ventiladores, aire acondicionado, luminarias) se encuentren firmemente sujetos de tal manera que no puedan caer.

a.4. Verificar que en todo momento se mantengan las rutas de salida o escape libres de cualquier obstáculo, de tal manera que permita la fluidez de la evacuación.

#### 9.5.1.2 DURANTE EL SISMO

b.1. Una vez iniciado el sismo se procederá a ubicarse en las zonas seguras señalizadas, hasta que cese el movimiento.

b.2. En las zonas de reunión se deberá esperar por lo menos 15 minutos, con la finalidad de prevenir una réplica, en este lapso los brigadistas verificarán que todo el personal haya evacuado a la zona de reunión. De ser necesario, se procederá a la evacuación del establecimiento.

b.3. Los brigadistas de emergencias determinarán si las condiciones permiten el retorno a las instalaciones.

#### 9.5.1.3 DESPUÉS DEL SISMO

c.1. Atender a personas lesionadas, si fuera el caso.

c.2. Evaluar los daños a los equipos e instalaciones del laboratorio, y emitir los informes correspondientes.



#### 9.5.2 EMERGENCIA POR INCENDIOS

##### 9.5.2.1 ANTES DEL INCENDIO

a.1. Los equipos de lucha contra incendios (mantas ignífugas, extintores, recipientes de agua o arena) deben colocarse cerca de las puertas de los ambientes y en puntos estratégicos de los pasillos y vestíbulos.

a.2. Verificar periódicamente el estado y funcionamiento de los equipos y sistemas contra incendios (extintores, mantas ignífugas, alarmas, etc.).

a.3. Dar a conocer a todo usuario que haga uso del laboratorio de biología, los procedimientos ante incendios, planos de seguridad, la ubicación de los extintores y mantas ignífugas.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>24 DE 75</b>	

a.4. Verificar que en todo momento se mantengan las rutas de salida o escape libres de cualquier obstáculo, de tal manera que permita la fluidez de la evacuación.

#### 9.5.2.2 DURANTE EL INCENDIO



- b.1. Buscar que se dé aviso al responsable del laboratorio o algún miembro de la brigada de emergencias.
- b.2. Mantener la calma y ayudar para que los demás la conserven y evitar que traten de realizar alguna acción que pueda ocasionar algún otro riesgo.
- b.3. Retirar los materiales o productos químicos inflamables que se encuentren cerca del fuego, en la medida de sus posibilidades.
- b.4. Tomar los extintores más cercanos y/o mantas ignífugas, y si el propio fuego lo permite, intentar combatirlo (ubicándose entre el fuego y la salida de escape)
- b.5. Si no sabe usar el extintor ni mantas, cierre puertas y ventanas (si la magnitud del fuego lo permite) y desaloje el lugar.
- b.6. Si no se puede controlar el fuego, se debe procurar apagar los equipos, retirar al personal lo más pronto posible de forma ordenada, siguiendo la ruta de evacuación, y esperar la llegada de la brigada contra incendios.
- b.7. Si un miembro de la brigada de emergencia se encuentra presente en el lugar del incendio, se quedará en el área y formará una brigada provisional para atacar la emergencia hasta que llegue la brigada titular.
- b.8. Si por alguna razón se queda atrapado por el humo, permanecer cerca del piso, ya que en esta área el aire es un poco más limpio y la respiración se deberá hacer por la nariz hasta liberarse del humo.

#### 9.5.2.3 DESPUÉS DEL INCENDIO

- c.1. Atender a personas lesionadas, si fuera el caso.
- c.2. Evaluar los daños a los equipos e instalaciones del laboratorio, y emitir los informes correspondientes.



*Handwritten signature*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>25 DE 75</b>	

## X. NORMAS DE SEGURIDAD.

### 10.1. NORMAS GENERALES



- a. Nunca comer ni beber dentro del laboratorio.
- b. No ingresar la institución bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos productos a los lugares de trabajo.
- c. Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos.
- d. No manipular equipos y/o materiales de laboratorio, si no se encuentra capacitado y debidamente autorizado.
- e. No Trabajar en el laboratorio si no tiene supervisión del encargado de practica o laboratorio.
- f. No llevar a cabo experimentos no autorizados.
- g. Mantenga limpia en todo momento su mesa de trabajo. Si derrama alguna sustancia, limpie inmediatamente el área afectada.
- h. Notifique inmediatamente, al encargado de la practica o laboratorio, de todos los accidentes u otras situaciones potencialmente peligrosas.
- i. Evite las bromas pesadas y los juegos en el laboratorio. Igualmente, evite las visitas, entradas y salidas en el laboratorio.
- j. Debe notificar de cualquier condición médica (alergias, dificultad visual, dificultad motora, etc.) que pueda afectar su seguridad en el laboratorio.
- k. Actuar con las precauciones necesarias dependiendo del peligro, no exponiéndose a situaciones de riesgo
- l. Hacer que las protecciones sean iguales (o superiores) al peligro. Emplear la protección adecuada para cada caso.



*Janet*

### 10.2. NORMAS DE SEGURIDAD ASOCIADOS CON EL RIESGO BIOLÓGICO.

- a. Las superficies de trabajo deberán ser descontaminadas una vez al día o después de derrame de material o sustancias biológicas.
- b. Antes de abandonar el laboratorio, realizar el lavado de manos adecuadamente.
- c. Cuando los agentes infecciosos que se emplean requieren de medidas de seguridad adicionales (estar vacunados), en la puerta debe estar indicado claramente el símbolo de "peligro o riesgo biológico".



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>26 DE 75</b>	

- d. Cuando se realicen ensayos con material biocontaminante, las puertas deben permanecer totalmente cerradas.
- e. Todas las actividades relacionadas con la manipulación de materiales infecciosos deberán realizarse en cabinas de bioseguridad.
- f. Las superficies de trabajo de las cabinas de bioseguridad deberán ser descontaminadas después que el trabajo haya finalizado.
- g. Solo ingresaran al laboratorio las personas autorizadas, y las personas con alto riesgo de contraer infecciones tienen prohibido el ingreso.
- h. Se deben utilizar guantes protectores para todos los procedimientos que tengan contacto directo con sangre, líquidos corporales y otros materiales potencialmente infecciosos. Después de utilizar los guantes deben ser retirados de forma aséptica y proceder con el lavado de manos.
- i. Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados, deberán ser descontaminados antes de su eliminación o esterilizados para su reutilización como tubos de ensayo, cajas Petri, entre otros.
- j. Después de cada práctica se deberá proceder con la higiene y limpieza del laboratorio.

### 10.3. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.

- a. No manipular sustancias químicas si no se tiene supervisión del encargado de practica o responsable del laboratorio.
- b. No realizar la manipulación de reactivos químicos sin autorización.
- c. Verificar qué sustancia química está utilizando. Para cumplir esta regla deberá leer la etiqueta o rótulo del envase (no utilizar sustancias desconocidas o sin rotulo).
- d. Cuando caliente líquido en tubos de ensayo, no dirigir la boca del tubo en dirección de algún compañero.
- e. No pipetear utilizando la boca y evitar inhalar vapores o gases.
- f. Determinar la naturaleza y grado de peligro (leer o interpretar cuidadosamente los riesgos y/o símbolos de peligro existentes en la etiqueta o rótulo del envase).
- g. No calentar líquidos en envases o sistemas cerrados.
- h. Evitar frotarse los ojos en el laboratorio, particularmente si ha manejado agentes químicos irritantes.





	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>27 DE 75</b>	

- i. No desechar residuos en el desagüe. Utilizar los recipientes o contenedores del laboratorio destinados para tal fin.
- j. No introducir pipetas o espátulas directamente en las botellas de reactivos. Transferir una cantidad del reactivo a usar, a un envase apropiado. No devolver los sobrantes a los frascos de origen.
- k. Mantenga limpia en todo momento su mesa de trabajo. Si derrama algún reactivo, limpie inmediatamente el área afectada.
- l. Notifique al encargado de la práctica o laboratorio inmediatamente de todos los accidentes al igual que de escapes de gas u otras situaciones potencialmente peligrosas.
- m. Conocer los procedimientos a seguir en casos de emergencia con sustancias químicas.
- n. Al preparar las soluciones, los envases no deberán quedar en contacto directo con el mesón por peligro de ruptura o derrame. Emplear un recipiente para colocar los envases en los cuales se preparará la solución. Esto evitará que al romperse un frasco o matraz la solución se derrame sobre el mesón. Realizar con precaución el trasvasije de un recipiente a otro; utilizar un embudo en caso necesario.
- o. Nunca se deberá agregar agua a los ácidos concentrados: esta acción genera una reacción exotérmica, la cual puede provocar la ruptura del vaso o receptáculo y causar derrame o salpicaduras que exponen a quemaduras de piel y mucosas.
- p. Agregar siempre el ácido suavemente al agua mientras mezcla. Esto se deberá realizar por escurrimiento de las paredes internas del receptáculo con agua.
- q. Mantener a mano neutralizantes, tales como bicarbonato de sodio (para los ácidos) y ácido acético (para los álcalis), en caso de derrames o salpicaduras.
- r. Nunca mezclar o combinar sustancias cuyos resultados son gases tóxicos, sin las medidas de seguridad adecuadas.
- s. Trabajar en mesones donde no exista fuente de calor, así se evitarán incendios y/o explosiones.
- t. Nunca abrir frascos que contengan líquidos o vapores inflamables (bencina, alcohol, éter) cerca de una fuente de calor que produzca llama (mechero).
- u. Antes de combinar o mezclar reactivos, se deberá comprobar que la reacción no provocará incendio y/o explosión, no realizar si fuera el caso.



*Jan*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95		
		FECHA:	Marzo - 2022		
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		<b>28 DE 75</b>

- v. Para evitar los incendios y/o las explosiones, las sustancias deben almacenarse y manipularse de modo que no puedan entrar en contacto con las sustancias.

Cuadro N°02: Relación de incompatibilidades químicas











CATEGORÍA DE SUSTANCIAS	SUSTANCIAS INCOMPATIBLES
<b>Metales alcalinos, como el sodio, potasio, cesio y litio.</b>	Dióxido de carbono, hidrocarburos clorados, agua.
<b>Halógenos.</b>	Amoniaco, acetileno, hidrocarburos.
<b>Ácidos acético, sulfhídrico y sulfúrico, anilina, hidrocarburos.</b>	Agentes oxidantes, como los ácidos crómicos y nítrico, los peróxidos o los permanganatos.



Fuente: OMS 2005. Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

## XI. SIGNOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Son los pictogramas que están estampados en las etiquetas de los productos químicos y que sirven para dar advertencia instantánea del tipo de peligro que entraña su uso, manipulación, transporte y almacenamiento de estos. Sin embargo, son solo una parte de un sistema de clasificación y etiquetado universal más grande que identifica y clasifica productos químicos peligrosos, que es usado en el laboratorio.

Cuadro N°03. Descripción de los pictogramas de peligrosidad.

				
<b>CORROSIVOS</b> Sustancias y preparados que en contacto con los tejidos vivos puedan ejercer sobre ellos una acción destructiva.	<b>INFLAMABLES</b> Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 21° C e inferior o igual a 55° C.	<b>EXPLOSIVOS</b> Sustancias y preparados que puedan explotar bajo el efecto de una llama o que son sensibles a los choques o a la fricción	<b>IRRITANTES</b> Sustancias y preparados no corrosivos que por contacto inmediato, con la piel o mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria.	<b>TÓXICOS</b> Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos graves, incluso la muerte.
				
<b>N</b>	<b>Xn</b>	<b>O</b>	<b>F+</b>	<b>T+</b>

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	FECHA:	Marzo - 2022	
		VERSIÓN:	01	
	PÁGINA:	<b>29 DE 75</b>		

<b>PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>NOCIVO</b>	<b>COMBURENTES</b>	<b>EXTREMADAMENTE INFLAMABLE</b>	<b>MUY TÓXICOS</b>
Sustancias y preparados cuya utilización presenta o puedan presentar riesgos inmediatos o diferidos para el medio ambiente.	La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden provocar daños para la salud agudos o crónicos.	Sustancias y preparados que en contacto con otros, particularmente con los inflamables, originan una reacción fuertemente exotérmica.	Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 0° C, y su punto de ebullición inferior o igual a 35° C.	La inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos extremadamente graves agudos o crónicos e incluso la muerte.

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.


a. Todos los productos han de estar identificados por el fabricante o proveedor por medio de la etiqueta. Ésta debe ofrecer información sobre:

- a.1. Contenido y su composición.
- a.2. Frases R: frases que describen el riesgo que plantea su uso.
- a.3. Frases S: frases que recomiendan las medidas que se han de aplicar para manejar con seguridad el producto.
- a.4. Pictogramas: se señalarán sus riesgos principales, para que de forma rápida y sin leer quede identificado el peligro de la sustancia.

b. Etiquetar debidamente las soluciones preparadas en el laboratorio. Toda etiqueta realizada en el laboratorio debe contener como mínimo:

- b.1. Nombre de la sustancia.
- b.2. Otros datos relevantes: concentración, grado de pureza, etc.
- b.3. Persona que la ha almacenado.
- b.4. Fecha
- b.5. Pictogramas de seguridad.
- b.6. Riesgos y precauciones básicas.

Figura 01. Descripción de la ficha del etiquetado del recipiente que contiene la sustancia química.

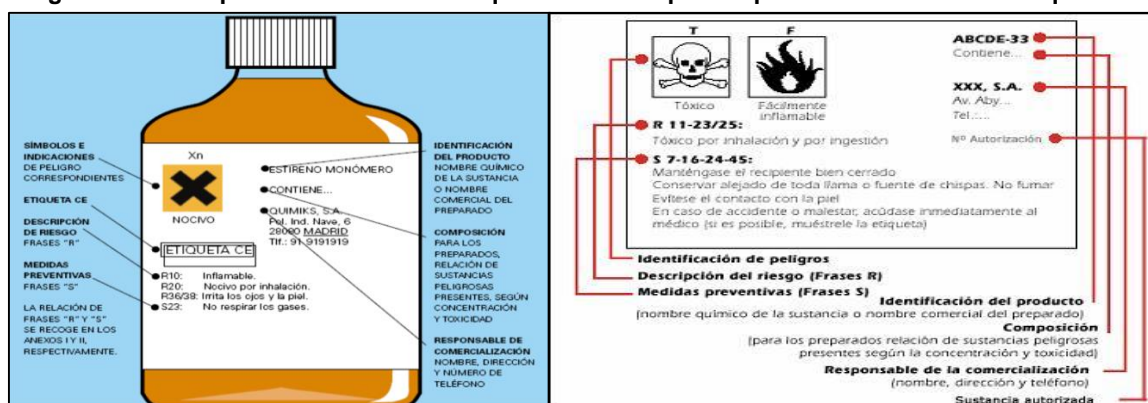

La impresión o copia adquiere el estado de **"DOCUMENTO NO CONTROLADO"**

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

### 11.1. SEPARACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Es imprescindible informarse de las incompatibilidades de las distintas sustancias químicas. Un almacenamiento conjunto de productos peligrosos incompatibles puede derivar en una explosión. Por ejemplo, los productos oxidantes o tóxicos deberán ir separados de los combustibles.

Figura 02. Resumen de incompatibilidad de almacenamiento de productos peligrosos

					
	+	-	-	-	+
	-	+	-	-	-
	-	-	+	-	+
	-	-	-	+	○
	+	-	+	○	+

+ Se pueden almacenar conjuntamente.  
 ○ Solamente podrán almacenarse juntos, si se adoptan ciertas medidas preventivas.  
 - No deben de almacenarse juntos.

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

### 11.2. EI ROMBO NFPA

El rombo de los materiales peligrosos está dividido en cuatro secciones. Cada sección tiene un color distinto y un número. El color se asocia con diferentes tipos de peligros. Azul para salud, rojo para inflamabilidad, amarillo para reactividad e inestabilidad y blanco para peligrosos específicos de algunos materiales, por ejemplo, si es radioactivo o si proviene de muestras biológicas.

Figura 03. Rombo NFPA.





Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

**Cuadro N°04. Información sobre los riesgos asociados a una determinada sustancia**

	NIVEL 0	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
AZUL	La exposición al material no presenta riesgos para la salud. No hay riesgos incluso en casos de ingestión o inhalación de grandes cantidades, por ejemplo el cloruro de sodio (sal común).	La exposición al material puede causar irritación y otros daños menores no persistentes incluso en ausencia de asistencia médica. Por ejemplo, la acetona o el bromato de sodio.	La exposición intensa, o prolongada, pero sin ser crónica, puede causar irritación y daños residuales con incapacitación temporal o permanente si no hay atención médica rápida. Por ejemplo, el éter dietílico o el cloroformo.	La exposición aguada durante poco tiempo puede causar daños serios temporales o daños residuales moderados incluso con atención médica inmediata. Por ejemplo, el cloro, hidróxido sódico o monóxido de carbono.	Exposiciones muy cortas pueden resultar letales o causar daños graves permanentes. Por ejemplo, cianuro, fosfano o ácido fluorhídrico.
ROJO	Materiales no inflamables en condiciones normales, por ejemplo, el tetracloruro de carbono. Se incluyen los materiales intrínsecamente no inflamables, por ejemplo cemento, que son aquellos que no se inflaman si se exponen al aire y se calientan hasta los 820 °C durante cinco minutos.	Materiales con un punto de inflamabilidad de 93° C o superior. Por ejemplo, la mayoría de aceites minerales. No entran en ignición en condiciones ambientales sin que haya precalentamiento.	Punto de inflamabilidad entre 38 y 93° C. Por ejemplo, el gasóleo. La ignición de estos materiales puede ocurrir si se exponen a temperaturas ambientales relativamente altas sin necesidad de calentamiento.	Punto de inflamabilidad entre 23° C y 38° C; también se incluyen líquidos con punto de inflamabilidad por debajo de 23° C y punto de ebullición igual o superior a 38° C. Estos materiales pueden arder bajo la mayoría de condiciones ambientales. Por ejemplo, acetona.	Punto de inflamabilidad por debajo de 23° C. Son líquidos que arden rápidamente y que a presión atmosférica y temperatura normal se vaporizan rápidamente dispersándose por el aire. Por ejemplo, acetileno, hidrógeno líquido o sustancias pirofosfóricas.



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	FECHA:	Marzo - 2022	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>32 DE 75</b>	

<b>A M A R I L L O</b>	<p>Materiales normalmente estables incluso cuando son expuestos al fuego y que no reaccionan con el agua. Por ejemplo, el helio.</p>	<p>Materiales normalmente estables pero que pueden volverse inestables ante condiciones de elevada presión y temperatura. Por ejemplo, el propileno y el acetileno.</p>	<p>Materiales que normalmente son estables pero que pueden sufrir cambios químicos bruscos a temperatura y presión elevada y materiales que reaccionan de forma violenta con el agua. Por ejemplo, el potasio, el sodio y sosa cáustica.</p>	<p>Materiales que pueden detonar si se exponen a algún agente que inicie la reacción. Se incluyen materiales que reaccionan de forma violenta con el agua o que pueden explotar si reciben una descarga eléctrica. Por ejemplo, nitrato amónico, trifloruro de cloro o el flúor.</p>	<p>Materiales susceptibles de detonación o descomposición explosiva bajo condiciones normales de presión y temperatura. Por ejemplo, nitroglicerina, dióxido de cloro o azida de sodio.</p>
<b>B L A N C O</b>	<p><b>OX:</b> Material muy oxidante que puede provocar la combustión de otros materiales sin presencia de aire. A veces se puede ver como OXY aunque el estándar NFPA 704 no recoge estas siglas. Por ejemplo, el perclorato potásico y el peróxido de hidrógeno.</p>		<p><b>W:</b> Material peligroso en contacto con agua. Por ejemplo, el celsio o el ácido sulfúrico.</p>		<p><b>SA:</b> Con las siglas de Simple Asphyxiant gas, en español gas asfijante simple. Es específico para los gases hidrógeno, nitrógeno, helio, neón, argón, krypton y xenón.</p>

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

## XII. SEÑALES DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

### 12.1. SEÑALES DE EVACUACIÓN

- 12.1.1. Se denominan así a las utilizadas para indicar las salidas de evacuación, material de primeros auxilios o a dispositivos de salvamento.
- 12.1.2. Para señalar la dirección hacia la salida de emergencia se podrán utilizar las siguientes formas:

Figura 04. Señales de salida de emergencia





Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

- 12.1.3. Las salidas estarán señalizadas.
- 12.1.4. Se colocarán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas.
- 12.1.5. Si existieran puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, se colocará la señal o rótulo "No hay salida" en lugar fácilmente visible.
- 12.1.6. No es conveniente disponer las señales en las hojas de las puertas, ya que, en caso de que éstas quedasen abiertas, no serían visibles.
- 12.1.7. Es aconsejable que el número de señales sea el imprescindible para satisfacer las necesidades de información, un número excesivo de señales

*La impresión o copia adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"*



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	FECHA:	Marzo - 2022	
		VERSIÓN:	01	
	PÁGINA:	<b>33 DE 75</b>		

puede confundir a los ocupantes.

12.1.8. Para señalar la dirección a los medios de primeros auxilios, así como su ubicación, se utilizarán las siguientes señales:

**Figura 05. Señales comunes de primeros auxilios**



Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

## 12.2. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

12.2.1. Se denominan así a las utilizadas para proporcionar indicaciones relativas a medios de protección, generalmente contra incendios (extintores, pulsadores manuales de alarma, entre otros).

12.2.2. Los medios de protección de utilización manual se deben señalar mediante señales en forma de panel, con pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

**Figura 06. Señales que indican equipos de Protección**



Fuente: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

## 12.3. SEÑALES DE ADVERTENCIA

12.3.1. Son señales que advierten de un riesgo o peligro; como por ej. Advertencia de riesgo eléctrico, sustancia o riesgo inflamable, piso resbaloso, entre otros.

**Figura 07. Señales que advierten Riesgos o Peligro.**

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SÍMBOLO	SEÑAL DE SEGURIDAD
ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO O PELIGRO DE MUERTE ALTO VOLTAJE		
SUSTANCIAS O MATERIAS INFLAMABLES O PELIGRO INFLAMABLE		
CUIDADO PISO RESBALOSO		
ATENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO		
CUIDADO SUPERFICIE CALIENTE		
CUIDADO BALONES DE GAS O TANQUES DE GAS		
SUSTANCIA TÓXICAS O PELIGRO DE MUERTE		

Elaboración propia

## 12.4. SEÑALES DE PROHIBICIÓN

12.4.1. Son señales que prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.

Figura 08. Señales de prohibición de actividades de riesgo en el laboratorio



Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

## 12.5. SEÑALES DE OBLIGACIÓN

12.5.1. Son señales que obligan a un comportamiento determinado.



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>35 DE 75</b>	

Figura 09. Señales de protección necesaria por cada actividad en los laboratorios



Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

### XIII. EQUIPOS DE PROTECCIÓN

#### 13.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Son elementos de ayuda en caso de emergencias (vertidos, salpicaduras, derrames, etc.). Deben mantenerse en buen estado y al alcance para que su uso pueda realizarse con la rapidez requerida, así como debidamente señalizados.

##### 13.1.1 LAVAOJOS



Es un sistema que debe permitir la descontaminación rápida y eficaz de los ojos y que está constituido básicamente por dos rociadores o boquillas capaces de proporcionar un chorro de agua potable para lavar los ojos o la cara, una pileta provista del correspondiente desagüe, de un sistema de fijación al suelo o a la pared y de un accionador de pie (pedal) o de codo. Se debe poder acceder a los lavaojos con facilidad y deben estar claramente señalizados y a cortas distancias de los puestos de trabajo en el laboratorio, de forma que la persona accidentada sea capaz de llegar a él con los ojos cerrados. Además, deben estar próximos a las duchas de seguridad (los accidentes oculares suelen ir acompañados de lesiones cutáneas) para que puedan lavarse ojos y cuerpo.

Figura 10. Lava ojos y señalización



Elaboración propia

#### Recomendaciones de uso

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>36 DE 75</b>	


- a) El agua no se debe aplicar directamente sobre el globo ocular, sino a la base de la nariz, esto hace que sea más efectivo el lavado de los ojos, extrayendo las sustancias químicas (los chorros potentes de agua pueden volver a introducir partículas en los ojos).
- b) Se debe forzar la apertura de los párpados para asegurar el lavado detrás de los mismos.
- c) Hay que asegurarse de lavar desde la nariz hacia las orejas; ello evitará que penetren sustancias químicas en el ojo que no está afectado.
- d) Deben lavarse los ojos y párpados durante, al menos, 15 minutos.
- e) Las duchas de ojos deben inspeccionarse cada 6 meses.

### 13.1.2 DUCHAS DE SEGURIDAD.

Constituyen el sistema de emergencia más habitual para casos de proyecciones con riesgo de quemaduras químicas e incluso si se prende fuego en la ropa (en este caso su aplicación sería posterior a la manta ignífuga).

El laboratorio cuenta con equipo Ducha-lavaojos en una sola estructura.

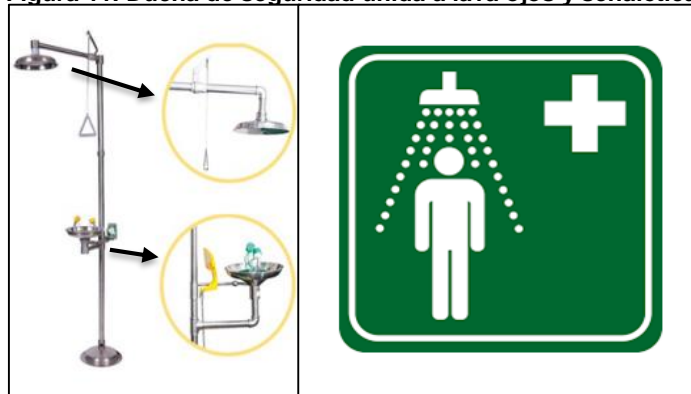

**Figura 11. Ducha de seguridad unida a lava ojos y señalética**



Elaboración propia

### Características de la ducha de seguridad

- a) La ducha proporciona un caudal de agua suficiente para empapar a la persona completa e inmediatamente.
- b) La distancia desde el suelo a la base del cabezal de la ducha permite el acomodo de la persona erguida. La separación desde la pared al cabezal permite acomodar, en caso necesario, a dos personas. La distancia desde el suelo al pulsador no superará los 2m.
- c) La válvula de apertura es de accionamiento rápido y fácil (jalador triangular unido al sistema mediante una barra fija).

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>37 DE 75</b>	

### 13.1.3 EXTINTORES

Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes. Sirven para dominar o extinguir cualquier tipo de fuego generado para evitar así su transformación en incendios mayores.

Figura 12. Extintor de tipo CO2 y señalética



### 13.1.4 MANTA IGNÍFUGA

Una manta ignífuga, manta cortafuegos, manta contra incendios es un dispositivo de seguridad diseñado para extinguir incendios incipientes o pequeños (amagos de incendio). Consiste en una lámina de material ignífugo que se coloca sobre el fuego con el fin de sofocarlo, al impedir la llegada de oxígeno.

Figura 13. Manta ignífuga y señalética





Elaboración propia

### 13.1.5 DETECTORES DE HUMO

Son dispositivos de alarma que se activan con la detección de humos generados por procesos de combustión, siempre y cuando el valor detectado sobrepase un umbral prefijado.

En el laboratorio están ubicados en la parte superior (techo), para facilitar la detección de humos.



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>38 DE 75</b>	

**Figura 14. Detector de humo de laboratorio de biología.**



Elaboración propia

### 13.1.6 LUCES DE EMERGENCIA

La luz de emergencia es un elemento completamente necesario en el laboratorio, especialmente en aquellos que se destinan a trabajar y que cuentan con varios ocupantes, como es el Laboratorio de Biología.

Se trata de alumbrado que se pone en funcionamiento en casos de fallo de alimentación en el alumbrado general, de modo que resulta especialmente útil para evitar situaciones de pánico que puedan derivar en generación de accidentes u otros problemas mayores.

**Figura 15. Luces de Emergencia**





Elaboración propia

### 13.1.7 BOTIQUÍN

- a) El botiquín debe contener elementos que ayuden a atender situaciones relacionadas con los diferentes tipos de lesión.
- b) El responsable del área debe ser el encargado de verificar una vez al mes el contenido del botiquín para hacer la reposición correspondiente.

**Figura 16. Botiquín de laboratorio de biología.**




	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95		
		FECHA:	Marzo - 2022		
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA</b>		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		<b>39 DE 75</b>



### 13.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

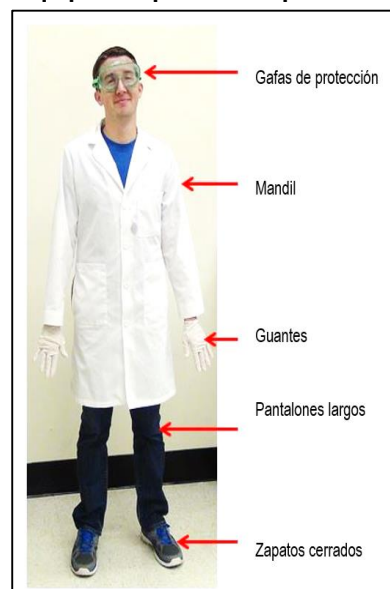

Figura 17. Equipos de protección personal EPP.



Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

La vestimenta y el equipo de protección personal pueden actuar como barrera para reducir al mínimo el riesgo de exposición o contacto con aerosoles, salpicaduras de sustancias químicas o biocontaminantes. Los EPP a utilizar dependen de la naturaleza del trabajo que se realice y estarán indicados en la realice en el laboratorio. En el laboratorio todos los usuarios llevarán ropa protectora, y antes de abandonar el laboratorio, tendrán que quitarse los EPPs y lavarse las manos.

Cualquier equipo de protección personal (EPP) que se haya utilizado NO se puede usar fuera del laboratorio.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	FECHA:	Marzo - 2022	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>40 DE 75</b>	

**Cuadro 05. Equipos de protección personal, peligros y características de seguridad.**

EPP	PELIGRO CONTROLADO	CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
<b>Bata o mandil de laboratorio</b>	Derrames o salpicaduras de sustancias químicas o biológicas	Abertura trasera. Cubren la ropa de vestir Es la 1era barrera ante productos peligrosos.
<b>Delantales de plástico</b>	Derrames o salpicaduras de sustancias químicas o biológicas	Material impermeable y resistente (vinilos, polietileno, etileno-alcohol vinílico, entre otros). Cubren la ropa de vestir Es la 1era barrera ante productos peligrosos.
<b>Calzado cerrado</b>	Impactos y salpicaduras en los pies.	Cubrir 100% del pie Material de cuero, cuerina, badana o sintético. Puntera cerrada.
<b>Lentes de seguridad</b>	Impactos y salpicaduras en ojos	Lentes resistentes a los impactos Protección lateral.
<b>Mascarillas respiratorias</b>	Inhalación de aerosoles. Bloqueo de gotas de productos químicos o biológicos para boca y nariz	Varios diseños disponibles: desechables, de un solo uso; purificadoras de aire, de cara entera o de media cara; purificadoras de aire eléctricas, de cara entera o con capucha; con suministro de aire.
<b>Guantes</b>	Contacto directo con sustancias biocontaminantes. Protección contra quemaduras, punciones o cortes.	De material látex, vinilo o nitrilo, aprobados para uso microbiológico, desechables. De cuero o badana, resistentes a altas temperaturas. De material tejido y jebe, para protección anticorte.

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

#### XIV. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Para la organización del trabajo en el laboratorio debe considerarse una adecuada gestión de residuos; tanto por razones de seguridad como económicas, que contemplen las posibilidades de minimización, procurando reutilizar o reciclar productos cuando sea posible, así como optimizar la gestión de stocks para no generar residuos.

##### 14.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

**Cuadro 06. Clasificación de Residuos**


TIPO DE RESIDUO	COLOR DE RECIPiente DE ALMACENAMIENTO/ ETIQUETAS	EJEMPLO DE RESIDUO
Metales	Amarillo	Papel aluminio, herramientas y piezas de metal que no estén impregnadas con sustancias químicas
Vidrio	Plomo	Residuos de vidrio (vasos, botellas, jarras, etc. No incluye restos de focos y fluorescentes)
Papel y cartón	Azul	Restos de papel de oficina, hojas de cuadernos y cartones de embalaje
Plástico	Blanco	Botellas de plástico (gaseosa, agua mineral y de salsas), Material de PVC, Tubería de PVC.
Orgánico	Marrón	Restos de alimentos, restos de plantas, entre otros.
No aprovechable	Negro	Papel metalizado, papel higiénico, paños húmedos, entre otros. RAEE.
Peligroso	Rojo	Productos químicos vencidos, Productos químicos usados, Muestras de Laboratorio, Asbesto, Pilas, Materiales y trapos impregnados con químicos

Fuente: Adaptado de la NTP 900.058-2019      Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

## 14.2. MANEJO DE RESIDUOS

### 14.2.1. MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Figura 18. Flujoograma de manejo de residuos no peligrosos

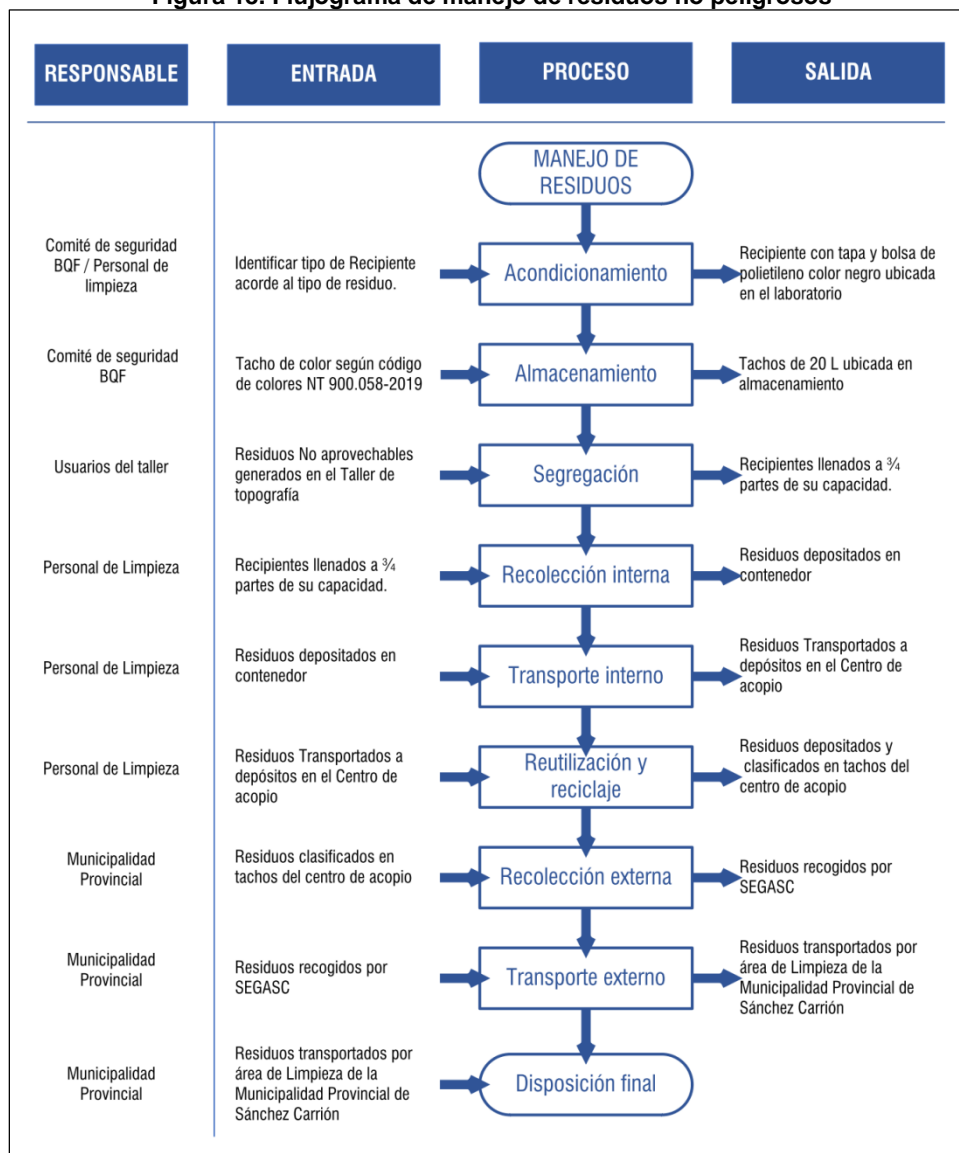



Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física

#### A. ACONDICIONAMIENTO

Esta etapa será realizada en la sede laboratorios de la UNCA, donde se tendrá contenedores con tapa y bolsas de polietileno, necesarios para la adecuada recepción y depósito de los diversos residuos generados en el laboratorio. Los contenedores serán del color o símbolo correspondiente (norma NTP 900.058-2019 de código de colores) según la tabla 08 "Clasificación de residuos".

**La impresión o copia adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"**

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>42 DE 75</b>	

Los contenedores deben ser llenados hasta las  $\frac{3}{4}$  partes. Esta actividad la responsabilidad es del Comité de seguridad biológica, química y física.

### B. ALMACENAMIENTO PRIMARIO

Se tiene un centro de acopio primario el cual cuenta con contenedores para residuos no peligrosos del laboratorio: papel y cartón (azul), plástico (blanco), metales (amarillo), orgánicos (marrón), vidrio (plomo) y no aprovechables (negro). Los encargados de realizar esta actividad es el personal de limpieza.

### C. SEGREGACIÓN

La segregación de residuos es un proceso de selección en categorías específicas en base a la naturaleza de los residuos, que se aplica en el laboratorio, se encargan de realizarlo los docentes, alumnos y personal administrativo, a través de la distribución adecuada en los depósitos del almacenamiento primario que está ubicado en la parte externa del laboratorio, según el código de colores, con el fin de asegurar la identificación y segregación de los mismos.

### D. RECOLECCIÓN EXTERNA

El personal de limpieza con los EPPS adecuados (botas, guantes de nitrilo, overol, mascarilla, lentes) es el encargado de la recolección del acopio primario y llevarlo a los contenedores municipales, El mismo que se realizará los días lunes, miércoles y viernes.

### E. TRANSPORTE EXTERNO


El área de Servicios de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (SEGAS) es la encargada de esta actividad.

### F. DISPOSICIÓN FINAL

El área de Servicios de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (SEGAS) es la encargada de su disposición final de los residuos no aprovechables y los residuos reciclables son llevados al área de SEGAS.

## 14.2.2. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Figura 19. Flujograma de procedimiento de residuos peligrosos.

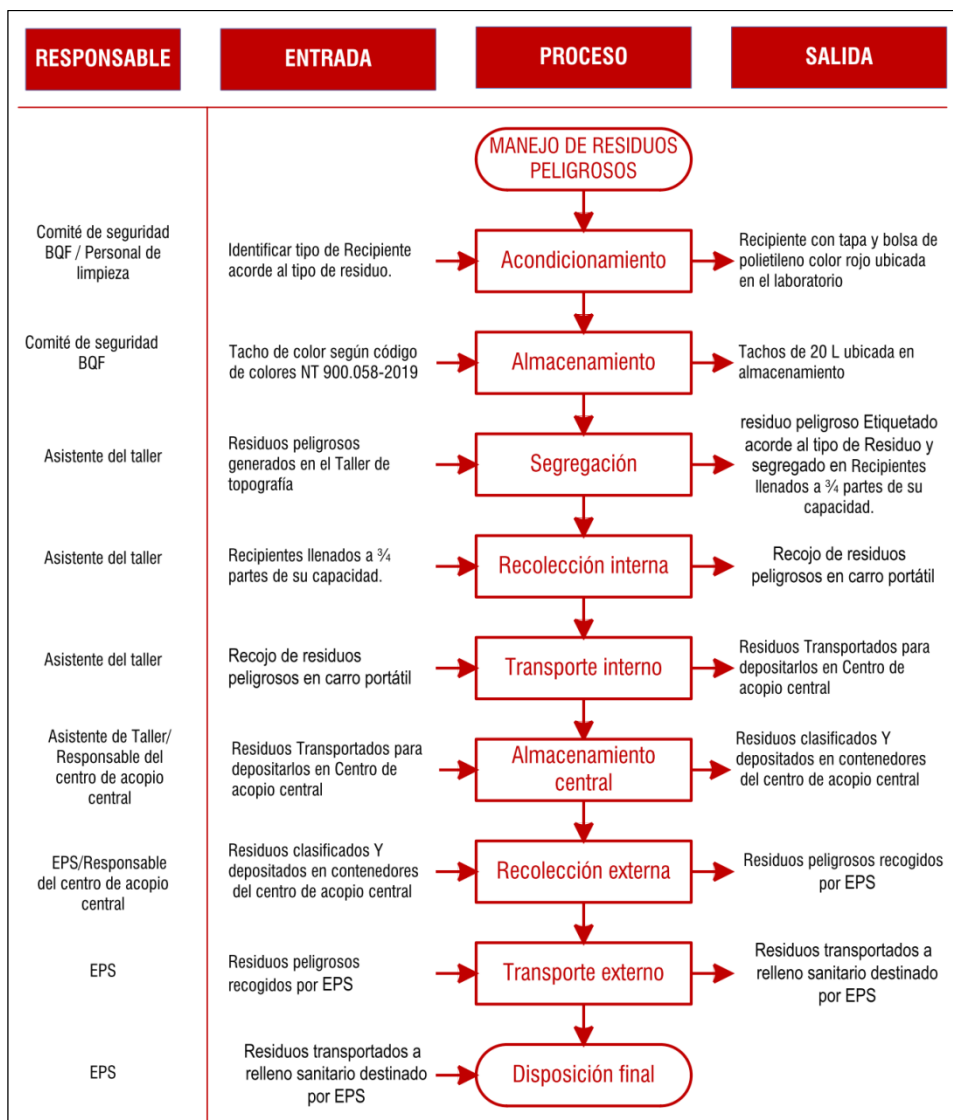

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física



## A. GENERACIÓN

En el Laboratorio de Biología se producen residuos peligrosos en estado sólido (trapos, envases contaminados, restos biológicos) y líquidos (químicos, fluidos biológicos), producto del desarrollo de prácticas. La identificación de las sustancias químicas y biológicas que conforman el residuo generado es de vital importancia por su peligrosidad. En caso de ser una mezcla, se debe tener en cuenta la posible reacción entre los compuestos.

## B. ACONDICIONAMIENTO

Consiste en el acondicionamiento de lockers ubicados debajo de la incubadora ECOCELL en el laboratorio, en donde estarán ubicados contenedores con tapa (con bolsas rojas en su interior) para residuos sólidos y una galonera de color

*La impresión o copia adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	FECHA:	Marzo - 2022	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>44 DE 75</b>	

rojo para residuos líquidos. Los recipientes deben ser llenados máximos hasta las  $\frac{3}{4}$  partes de su capacidad.

Los contenedores deben estar etiquetados con las siguientes etiquetas para su respectiva identificación:

Figura 20. Etiquetado para la segregación de los residuos peligrosos.



Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física

### C. ALMACENAMIENTO PRIMARIO

Se almacenará el residuo peligroso etiquetado y rotulado de acuerdo a su estado y condición, tomando en cuenta:

- c.1. No almacenar residuos químicos en lugares diferentes al área estipulada para tal fin.
- c.2. Debe ser zonas de poco tránsito y lejos de toda fuente de calor o de la incidencia de la luz directa del sol.
- c.3. Mantener el área de almacenamiento dentro del laboratorio en condiciones apropiadas de orden y limpieza.
- c.4. Los líquidos inflamables, corrosivos, tóxicos y peligrosos para el ambiente, deben diluirse 1/10 (V/V) y depositar en el recipiente que se encuentra en el laboratorio.

Figura 21. Recipientes para la segregación de los residuos peligrosos



Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física



#### D. SEGREGACIÓN

La segregación de residuos es un proceso de selección en categorías específicas en base a la naturaleza de los residuos, se aplica en el almacenamiento primario en el laboratorio, donde se determina la peligrosidad del residuo y se identifica el tipo de residuo peligroso y luego se separa adecuadamente, sin mezclar los residuos peligrosos, evitando aquellas mezclas que supongan un aumento de peligrosidad o que dificulten su gestión. Luego, se diligencia todos los campos de la etiqueta diseñada para residuo y se coloca según corresponda, inmediatamente después se fija la etiqueta firmemente sobre el envase. Esta etapa la realiza el asistente de laboratorio.

Figura 22. Etiqueta para el rotulado de los residuos peligrosos

**RESIDUO PELIGROSO**

Código: \_\_\_\_\_

Nombre del residuo: \_\_\_\_\_

Laboratorio: \_\_\_\_\_

Fecha de generación de residuo: \_\_/\_\_/\_\_

Fecha de almacenamiento de residuo: \_\_/\_\_/\_\_

N°

—




—



—











—

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física

Cuadro 07. Clasificación de residuos peligrosos

CODIGO	NOMBRE DEL RESIDUO PELIGROSO	TIPO DE RESIDUO PELIGROSO	COLOR	ROTULO
RP1	QUIMICOS	RESIDUO LÍQUIDO PELIGROSO QUÍMICO	 Rojo	 RIESGO QUÍMICO
RP3	BIOSANITARIOS Y QUIMICOS CITOTOXICOS)	RESIDUO SÓLIDO PELIGROSO INFECCIOSO	 Rojo	 RIESGO BIOLÓGICO
RP4	CORTOPUNZANTES		 Rojo	 RIESGO BIOLÓGICO

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	FECHA:	Marzo - 2022	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>46 DE 75</b>	

RP5	ANATOMOPATOLOGICOS Y ANIMALES	RESIDUO SÓLIDO PELIGROSO NO INFECCIOSO	 Rojo	 RIESGO BIOLÓGICO
RP6	EPPs ,ENVASES CONTAMINADOS CON QUIMICOS PELIGROSOS		 Rojo	 RIESGO QUIMICO
RP7	TRAPOS CONTAMINADOS CON QUÍMICOS PELIGROSOS		 Rojo	 RIESGO QUIMICO
RP8	PILAS		 Rojo	 RIESGO QUIMICO
RP9	LUMINARIAS		 Rojo	 N PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física



### E. RECOLECCIÓN INTERNA

Los residuos son llevados por el asistente del laboratorio los días viernes previa coordinación con el responsable del centro de acopio central para su traslado y recepción respectivamente. El traslado se realiza en un carro portátil. El responsable del centro de acopio central debe contar con sus EPPs adecuados y en buen estado como guantes, mandil, zapato cerrado, mascarilla.

### F. TRANSPORTE INTERNO

El asistente del laboratorio es el encargado del transporte de los residuos peligrosos desde el laboratorio al centro de acopio central, lugar donde es recepcionado por el responsable del centro de acopio central, quien firma una ficha de manejo interno de generación de residuos peligrosos del laboratorio.

Figura 22. Carro portátil para residuos peligrosos

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>47 DE 75</b>	



Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física

### G. ALMACENAMIENTO CENTRAL

La UNCA cuenta con un centro de acopio central de residuos peligrosos, el cual tendrá contenedores donde se acopiará temporalmente los residuos peligrosos ya sean sólidos o líquidos para su posterior recolección externa por una EPS. Estos residuos peligrosos serán entregados por el asistente de laboratorio al responsable del centro de acopio central de la UNCA.

### H. RECOLECCIÓN EXTERNA

Se coordinará con la EPS, la recolección y el transporte de los residuos peligrosos almacenados en el centro de acopio central, el cual se podrá realizar de manera mensual. Se llevará el control de la cantidad y tipo de residuos recolectados, en conjunto con la EPS.

### I. TRANSPORTE EXTERNO



El transporte de los residuos peligrosos se realizará a través de una EPS.

### J. DISPOSICIÓN FINAL.

Los residuos peligrosos, se depositará en los rellenos sanitarios establecidos, los residuos serán retirados, transportados y enviados al lugar autorizado, por la empresa que preste el servicio de retiro de residuos peligrosos (EPS).

## 14.2.3. MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS – RAEE

### A. GENERACIÓN

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>48 DE 75</b>	

La generación de los RAEE en el laboratorio se da cuando los equipos, dispositivos u otros aparatos eléctricos o electrónicos han alcanzado el fin de su vida útil (por obsolescencia o uso).

Estos serán almacenados por el asistente de laboratorio, antes de ser dados de baja, en un ambiente destinado para tal fin (Caja negra para RAEE ubicado en el interior de un locker del laboratorio).



## B. SEGREGACIÓN

El asistente informa al jefe de laboratorio sobre los AEE que presenten daño irreparable, obsolescencia o hayan sido reemplazados por renovación, y este comunica al Director General de Administración para que autorice a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación la verificación de dichos AEE para dar la baja, para ello se llena un formato de baja del equipo que se entrega al Jefe del laboratorio para que este haga seguimiento de la comunicación de baja del equipo. El equipo continúa almacenado en el interior del laboratorio, en el espacio destinado para tal fin.

## C. RECOLECCIÓN INTERNA

El jefe del laboratorio debe recibir:

- c.1. La baja del equipo por parte de la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación
- c.2. La orden de traslado del equipo para su almacenamiento temporal en el almacén de bienes en desuso por parte de la Unidad de Gestión Patrimonial.
- c.3. El asistente de laboratorio verifica que el equipo no contenga algún elemento peligroso, antes de ser considerado RAEE.
- c.4. El asistente del laboratorio y personal de limpieza realizan el embalado, etiquetado y rotulado del RAEE.
- c.5. El personal para esta actividad debe contar con EPPs adecuados y en buen estado (botas o zapato cerrado, guantes de nitrilo o guantes antideslizantes, overol o mandil, mascarilla y lentes protectores).
- c.6. El RAEE será trasladado al almacén de bienes en desuso ubicado en la Sede Académica, por el personal de limpieza y el chofer de la UNCA, bajo estrictas medidas de seguridad.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>49 DE 75</b>	

c.7. Previo al traslado el personal de limpieza firma el registro de salida de RAEE del laboratorio a pedido del asistente del laboratorio.

Figura 23. Etiqueta de los RAEE

**RAEE**

Generador: \_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_

Categoría RAEE: \_\_\_\_\_

Destino: \_\_\_\_\_

Peso estimado: \_\_\_\_\_

Fecha de salida: \_\_\_\_\_

Fecha almacenamiento: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física



#### D. ALMACENAMIENTO TEMPORAL


Los RAEE son recepcionados por el responsable del almacén de bienes en desuso, quien verificará que estén debidamente embalados, etiquetados y rotulados; llenará la etiqueta con la fecha de almacenamiento y procederá a llenar el registro de ingreso y salida de RAEE, y procederá a almacenarlos, alcanzando luego una copia física o digital del registro de ingreso y salida de RAEE al CSBQF.

#### E. DISPOSICIÓN FINAL

El almacén de bienes en desuso entrega los RAEE a la EPS o la institución beneficiaria de los RAEE para su traslado, asimismo, es el encargado de la custodia de las guías de remisión y manifiestos y de enviar una copia digital o física de cada documento al Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.

Figura 24. Flujograma de manejo de RAEE en el laboratorio.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	FECHA:	Marzo - 2022	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>50 DE 75</b>	

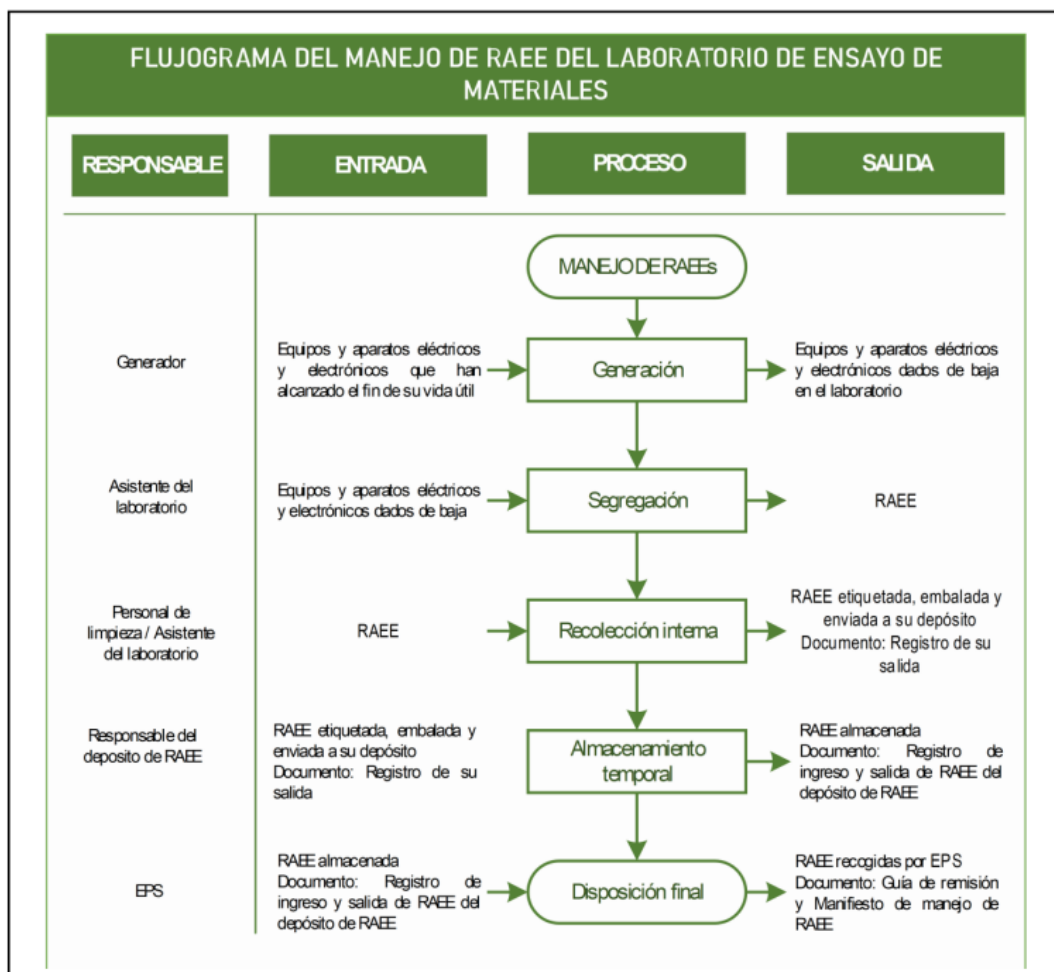

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física

## XV. MANEJO DE SUSTANCIAS



La exposición a las sustancias peligrosas (Biológicas y químicas), en las actividades realizadas en el laboratorio de biología, se da con mucha frecuencia, y estas sustancias pueden tener efectos contra la salud y la seguridad de las personas que los manejan o las instalaciones que los contienen, generando enfermedades, accidentes de trabajo por contacto, incendios y hasta explosiones. Por lo cual se establecen los lineamientos mínimos para su adecuado manejo.

### 15.1. MANEJO DE SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

Los productos o sustancias biológicas son producidos por agentes biológicos que constituyen un factor de riesgo laboral por su capacidad de poder desencadenar enfermedades.

#### 15.2.1. Residuo biológico



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01		
	PÁGINA:	<b>51 DE 75</b>		

Comprende al material biológico, sus residuos y todos los materiales no reutilizables que entraron en contacto con fluidos corporales, como: gasa, algodón, restos de tubos recolectores y de transferencia, materiales punzo cortantes, guantes desechables y otros materiales no reutilizables que entraron en contacto con fluidos corporales.

Este residuo se deposita en recipiente identificado con el símbolo de riesgo biológico, asimismo, utilice un recipiente que resista a la esterilización por autoclave y que no se rompa.

Ese tipo de residuo tiene que ser descontaminado antes de ser encaminado para su descarte final.

#### 15.2.2. Proceso de descontaminación

La descontaminación consiste en la utilización de procesos que eliminan total o parcialmente microorganismos, y permita que cualquier material sea seguro para su descarte final o para su reutilización.



Para la descontaminación son utilizados los procesos de desinfección y/o esterilización:

- a. **Desinfección:** Proceso que implica el uso de agentes químicos en objetos inanimados como superficies de trabajo, pisos, equipamientos.

La desinfección elimina todos los microorganismos no formadores de esporas.

El proceso consiste en:

- a.1. Adicione hipoclorito de sodio al 2% hasta la mitad del recipiente. Se recomienda la utilización del hipoclorito porque es un buen desinfectante para disminuir la cantidad de microorganismos posibles reduciendo los riesgos en el caso de accidente en la mesa de trabajo.
- a.2. Coloque ese recipiente con hipoclorito en su mesa de trabajo y coloque los residuos dentro de él, a medida en que sea generado.
- a.3. Disponga los residuos garantizando que ellos queden sumergidos. Pare de colocar materiales cuando el volumen alcance 2/3 de la capacidad del recipiente. Arriba de ese volumen, el hipoclorito puede perder su poder de desinfección, una vez que el cloro es consumido por la materia orgánica presente. Además, arriba de ese volumen, el

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BILOGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>52 DE 75</b>	

aumento de la presión interna provocada por la formación de gases, podrá provocar el derrame del líquido.

- a.4. Tape el recipiente y deje los materiales en inmersión por 24 horas.
- a.5. Vierta el hipoclorito y descártelo en el vertedero. Ese procedimiento no ofrece riesgos para el medio ambiente, una vez que, después de 24 horas, el cloro ya se evaporó.
- a.6. El proceso de desinfección con hipoclorito al 2% garantiza la desinfección de todo el material, pero al sufrir una serie de diluciones y evaporación, es deficiente en presencia de gran cantidad de materia orgánica. por lo tanto, al drenar ese hipoclorito, usted estará vertiendo material contaminado en el vertedero.
- a.7. Luego, encamine el recipiente con los residuos para la esterilización por autoclave.



**b. Esterilización:** Proceso que garantiza la eliminación de cualquier forma de vida. El método habitualmente usado para esterilización es el del uso de autoclave (calor húmedo bajo presión).

b.1. Cualquier material que entre en contacto con fluidos biológicos de cualquier origen debe pasar por proceso de descontaminación antes de la reutilización o encaminamiento para descarte final, porque, los fluidos biológicos son potencialmente infectantes.

b.2. Se debe usar durante el proceso de descontaminación los equipos de protección personal, como: Zapatos cerrados, bata por debajo de las rodillas y con mangas largas, guantes y protector facial y/o lentes impiden que líquidos contaminados y/o corrosivos entren en contacto con la piel y las mucosas.

## 15.2. Sustancias químicas

Estas producen efectos nocivos para la salud, debido a sus propiedades físicas y químicas que los caracterizan, al estar en contacto con ellas siempre existe riesgo de intoxicación, por ello se debe cumplir y respetar las normas de seguridad dispuestas en el ambiente de trabajo.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>53 DE 75</b>	

### 15.2.1. Clasificación

Se podrá clasificar las sustancias peligrosas en forma correcta de acuerdo con:

#### a. Inventario

La lista del inventario de sustancias peligrosas deberá exhibirse en lugares donde se almacenen estas sustancias y contendrá la siguiente información:

- a.1. Nombre del producto (nombre común).
- a.2. Dirección del fabricante / proveedor.
- a.3. Lugar donde está almacenada la sustancia.
- a.4. Cantidad almacenada.
- a.5. Propósito / uso de la sustancia.
- a.6. Hojas de Seguridad en idioma español (MSDS exhibidas y también archivadas).

El inventario de productos químicos es actualizado por el área de almacén de laboratorio, el cual se documentará en el formato de inventario de sustancias peligrosas.



#### b. Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS)

- b.1. Para cada sustancia peligrosa o potencialmente peligrosa en el lugar de trabajo o almacenamiento se requieren de hojas MSDS, las cuales se deberán mantener en un lugar designado en el almacén y donde se haga uso de la sustancia.
- b.2. Las MSDS deberán estar escritas en español para una mejor comprensión del personal. Todo usuario deberá de estar capacitado en el entendimiento de las hojas MSDS.

### 15.2.2. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

En el proceso de recepción y almacenamiento de sustancias peligrosas se toma en cuenta lo siguiente:

- a. Antes del almacenamiento:
  - a.1. Revisar los envases de las sustancias químicas, que deben estar apropiadamente etiquetados. En caso, no cuente con las

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>54 DE 75</b>	

especificaciones de rotulación se debe devolver inmediatamente al proveedor.



- a.2. Verificar que el envase se encuentre en buen estado, caso contrario reportar inmediatamente al jefe de laboratorio y proveedor.
- a.3. Revisar si el almacén esta acondicionado, para el almacenaje del envase que contiene la sustancia química, de acuerdo a su naturaleza, ya sea a temperaturas de refrigeración o ambiente.
- a.4. La persona que realice la actividad de manipulación de sustancias debe estar capacitada, utilizar los elementos de protección personal adecuados y hacerlo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y las hojas de seguridad del material.
- a.5. Clasificar las sustancias químicas según su peligrosidad e inflamabilidad (revisar cuadro de compatibilidad de almacenamiento de sustancias peligrosas).

b. Durante el almacenamiento:

- b.1. Trasladar recipientes con sustancias químicas, haciendo uso de las herramientas necesarias que faciliten la actividad.
- b.2. Iniciar el almacenamiento, colocando los envases pesados o voluminosos en los estantes inferiores, al igual que aquellas sustancias con mayor nivel de riesgo por corrosión o contacto. Almacenar en estante o gabinetes en las áreas de trabajo de tal manera que los recipientes que contienen líquidos y son de mayor capacidad vayan abajo, los frascos altos hacia atrás y los pequeños adelante; los productos más peligrosos abajo y los más inofensivos arriba.
- b.3. Toda sustancia peligrosa que ingrese a las instalaciones y almacén, debe etiquetarse (si no se encuentra etiquetado).
- b.4. Debe ser almacenado con otros reactivos que no tenga incompatibilidad reactiva.

c. Después del almacenamiento:

- c.1. Realizar inspecciones periódicas a sistema eléctrico del almacén y a los recipientes contenedores de las sustancias peligrosas para localizar fugas, daños mecánicos o señales de deterioro de la etiqueta; en caso de existir reportar al jefe inmediato.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>55 DE 75</b>	

c.2. Toda el área debe mantenerse libre de polvo, trapos, basura, disponiendo de recipientes adecuados metálicos o plásticos para recoger los residuos en forma regular.

### 15.2.3. ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

- a. Cualquier sustancia que sea peligrosa puede eventualmente convertirse en un residuo peligroso.
- b. Las sustancias peligrosas que no pueden ser usadas o devueltas al fabricante deberán ser eliminadas como residuos peligrosos.
- c. Las sustancias peligrosas deberán ser eliminados de acuerdo con lo dispuesto en las hojas MSDS y su recojo, transporte y disposición final estará a cargo de la empresa prestadoras de servicios EPS.



### 15.2.4. REGISTROS DEL MANEJO ADECUADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

El asistente de laboratorio deberá mostrar los registros necesarios que evidencien que está realizando un adecuado manejo de las sustancias peligrosas e inflamables, el cual será evaluado en la supervisión que realice el Comité de Seguridad Biológica, Química y Física de la UNCA.

## XVI. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

Las actividades de supervisión en los ambientes del laboratorio de materiales de construcción, suelos y geología son realizadas por el Comité de Seguridad Biológica, Química y Física, las cuales se aplican de forma aleatoria e inopinada contrastando los procedimientos establecidos con las actividades que se estén realizando en donde se incluye su pertinencia y vigencia. En este contexto se menciona los siguientes puntos a tener en cuenta:

- 16.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles de manera adecuada según la matriz IPERC.
- 16.2. Accesibilidad a los procedimientos existentes.
- 16.3. Implementación del protocolo.
- 16.4. Registro de inspecciones.
- 16.5. Registro de charlas, capacitaciones y/o inducciones.
- 16.6. Equipos de protección colectiva

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>56 DE 75</b>	

## XVII. INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD



- 17.1. La Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA), cuenta con instalaciones adecuadas en los laboratorios, que ayudan en la prevención de accidentes.
- 17.2. Asimismo, presenta señalización y equipamiento adecuada para casos de emergencia en las rutas de escape y cumplir con los requisitos básicos según Defensa civil.
- 17.3. Equipamiento y mobiliario: El laboratorio cuenta con un solo ambiente, con tres mesas fijas de concreto con capacidad para 6 personas por cada mesa, como máximo, y 16 bancas de madera para los estudiantes en todo el laboratorio (5 bancas por mesa, aproximadamente).
- 17.4. El laboratorio tiene dos entradas/salidas para todos los usuarios del laboratorio, así mismo pueden ser usados como salidas de emergencia.
- 17.5. Los equipos que forman parte del laboratorio se encuentran inventariados de acuerdo al formato 5.2, y en correspondencia a las guías de práctica que son entregadas a los estudiantes antes del inicio de cada practica de laboratorio.
- 17.6. El Laboratorio de Biología tiene un aforo de 17 personas.

## XVIII. CONTACTOS DE EMERGENCIA

Cuadro 09. Lista de Contactos de Emergencia

INSTITUCIÓN	TIPO DE APOYO	RESPONSABLE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
<b>CUERPO DE BOMBEROS</b>	-Primeros Auxilios -Extinción de incendios -Búsqueda y rescate en espacio confinados	Compañía de Bomberos	Pje. Hospital Cuadra 4 S/N	949437973 / 949437936
<b>POLICÍA NACIONAL</b>	-Orden Público	Comisaría PNP-HCO	Jr. Sánchez Carrión N° 1321	044 441289
<b>DEFENSA CIVIL</b>	-Soporte de suministros. -Evacuación de víctimas.	Secretaria técnica distrital	Jr. Mario Florián Saénz S/N	980145620
<b>FISCALÍA</b>	-Apoya en el restablecimiento del orden público	Fiscal de turno	Jr. Leoncio Prado N° 180	951298195
<b>HOSPITAL LEONCIO PRADO</b>	-Apoya en la atención de víctimas.	Jefe de emergencia	Jr. Sánchez Carrión Cuadra 13	960593455
<b>POSTA MÉDICA ES SALUD</b>	-Apoya en la atención de víctimas.	Jefe de emergencia	Jr. Sánchez Carrión Cuadra 16	044 481313 044 445019





	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>57 DE 75</b>	

<b>SERENAZGO</b>	-Apoya en el restablecimiento del orden público	Representante	Av. 10 de julio S/N	949437973 / 949437936
<b>HIDRANDINA</b>	-Apoya en el restablecimiento del fluido eléctrico	Representante	Jr. José Balta N° 219	044 481313
<b>CENTRO DE EMERGENCIA MUJER-CEM</b>	-Apoya en la violencia contra la mujer	Representante	Jr. Leoncio Prado N° 786	994833506 Línea 100

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.



*Handwritten signature*



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
		FECHA:	Marzo - 2022	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>58 DE 75</b>	

### XIX. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	Resolución de Comisión Organizadora N° 0121-2022/CO-UNCA.	Aprueba el Protocolo de Seguridad del Laboratorio de Biología de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
	Fecha: 23 de marzo del 2022	




*Handwritten signature*

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95	
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>	FECHA:	Marzo - 2022	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>59 DE 75</b>	

## XX. ANEXOS

### Anexo N° 1. Formato de inspección diaria

		<b>REGISTRO</b>										Código:		PDI-RE-			
		<b>INSPECCIÓN DIARIA DE SEGURIDAD</b>										Version:		001			
TIPO DE INSPECCIÓN:		Planificada:	No Planificada:	Otro (Detallar):						SEMANA: del ___ al ___ de _____							
AMBIENTE:										TURNO:							
Responsable del ambiente:										Firma del responsable de inspección:							
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:																	
N°	Condición a inspeccionar	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Observación / Recomendación
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
01	Las rutas de evacuación se encuentran libres de obstáculos																
02	El piso resbaladizo o mojado.																
03	Los equipos de protección colectiva están operativos.																
04	Se cuenta con equipos de primeros auxilios ubicados y operativos																
05	Tomacorrientes, interruptores y luminarias en buen estado y operativos																
06	El servicio de agua y gas se encuentran en buen estado.																
07	El ambiente cuenta con el mobiliario necesario en buen estado																
08	Las señalizaciones son adecuadas																
09	Se cuenta con sustancias rotuladas, MSDS u otros etiquetados correspondientes.																
10	Los equipos cuentan con baterías en buen estado o esta correctamente cargados.																
11	Los equipos, materiales o instrumentos se encuentra operativos y sin daños.																
12	Los equipos se encuentran calibrados																
13	Guardas de protección o empaquetaduras de los equipos en buenas condiciones																
14	Otro: _____																
15	Otro: _____																
Otras observaciones: _____		<b>RESPONSABLE DEL REGISTRO</b>															
_____		Nombres y apellidos:										FIRMA:					
_____		Cargo:				DNI:											



*Jan [Signature]*



**OTRO DOCUMENTO**

---

**PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA**

CÓDIGO: PDI-OD-95  
 FECHA: Marzo - 2022  
 VERSIÓN: 01  
 PÁGINA: **60 DE 75**



**Anexo Nº 2. Formato de registro de control de traslado de residuos peligrosos**

REGISTO								Código:	PDI-RE-
SALIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LABORATORIOS Y TALLERES								Versión:	001
								Fecha:	17/12/2021
								Nº de registro:	001
								Registro del ____ al ____ de ____	
LOCAL GENERADOR: Marcar con "X"									
LOCAL SL01-PRIALE ( )			LOCAL SL02-GARCILAZO ( )			LOCAL SL03-GRAU ( )			
LABORATORIO/TALLER:								Firma:	
RESPONSABLE DE AMBIENTE:									
Nº	FECHA	CÓDIGO DE ETIQUETA	TIPO	CARACTERÍSTICA	PESO	CONSIGNADO	DESTINO	FIRMA	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
Responsable del registro:									
NOMBRES Y APELLIDOS:								Firma:	
FECHA:			CARGO:			DNI:			



*Handwritten signature*



**OTRO DOCUMENTO**

---

**PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA**

CÓDIGO:	PDI-OD-95
FECHA:	Marzo - 2022
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	<b>61 DE 75</b>



**Anexo N° 3. Formato de registro de control de traslado de RAEE**

	<b>REGISTRO</b>							Código:	PDI-RE-
	<b>SALIDA DE RAEE</b>							Versión:	002
								Fecha:	6/12/2021
							Período del registro del ___ al ___ de _____		
<b>LOCAL GENERADOR: Marcar con "X"</b>									
LOCAL SL01-PIRALE ( )			LOCAL SL02-GARCILAZO ( )			LOCAL SL03-GRAU ( )			
AMBIENTE:							Firma:		
RESPONSABLE DE AMBIENTE:									
N°	FECHA	CODIGO DE ETIQUETA	CATEGORÍA DE RAEE	CARACTERÍSTICA	PESO ESTIMADO	CONSIGNADO	DESTINO	FIRMA	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
<b>Responsable del registro:</b>									
NOMBRES Y APELLIDOS:							Firma:		
FECHA:			CARGO:			DNI:			



*Handwritten signature*



# OTRO DOCUMENTO

CÓDIGO:

PDI-OD-95

FECHA:

Marzo - 2022

## PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

62 DE 75



### Anexo Nº 4. PETS de Uso de equipos del laboratorio de Biología

	<b>PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO</b>	CÓDIGO:	-UNCA
		FECHA:	AGOSTO 2021
		VERSIÓN : 01	PAGINA: 1 de 4
<b>USO DE AUTOCLAVE</b>			

<b>I. PERSONAL:</b>			
a. Asistentes de Laboratorio			
b. Docentes			
c. Estudiantes			
d. Otros usuarios			
<b>II. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:</b>			
a. Guantes de nitrilo		d. Zapato cerrado	
b. Lentes de seguridad (si fuera indicado)		e. Tapaboca	
c. Mandil		f. Guantes de cuero o badana (si lo amerita)	
<b>III. EQUIPO / MATERIALES:</b>			
a. Autoclave		c. Papel de esterilización, bolsa para esterilizar, gasa u otros.	
b. Placas Petri, frascos, tubos de ensayo, y otros.		d. Pinzas o tenazas	
<b>IV. PROCEDIMIENTO:</b>			
<b>PASOS OPERACIONALES</b>	<b>PELIGRO</b>	<b>RIESGO</b>	<b>MEDIDAS DE CONTROL</b>
1. Traslado de equipo y materiales al lugar de trabajo	Piso resbaladizo u obstáculos en el camino.	-Resbalones, tropezones, golpes, contusiones, raspones.	- Revisar que el piso por donde se realizará el transporte, no se encuentre con obstáculos ni esté resbaladizo.
2. Abastecimiento de agua destilada en tanque de autoclave.	Derrame de agua sobre el equipo  Descarga eléctrica  Piso mojado y resbaladizo	-Electrocución  -Daños al equipo.  -Resbalones, caídas a nivel	-El equipo debe estar desconectado. -Verter el agua a través de la entrada correspondiente al tanque de agua, cuidando de no derramar el líquido sobre el equipo. -Cerrar correctamente la tapa del tanque de agua. -Dejar el piso totalmente seco, en caso haya existido derrame.
3. Preparación de material	Contacto con muestras biológicas (con potencial contaminante o infeccioso)  Contacto con material punzocortante	Infección con microorganismos, enfermedades.  Laceraciones, cortes, heridas.	-Revisar que el material se encuentre en buen estado (sin rajaduras, roturas ni fisuras) -Limpiar el material si fuera necesario (para evitar contaminación al equipo causado por residuos como sangre u otros). -Cubrir todo el material con papel, bolsa de esterilizar, gasa u otro material para esterilizar. -Membretar cada material para su identificación. -Utilizar guantes de nitrilo durante toda la actividad. -No trate en el autoclave materiales inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos o radioactivos
4. Colocación de material	Contacto con superficies calientes	Quemaduras	-Tener cuidado de no tocar el interior del equipo en caso haya sido recientemente utilizado, en dicho caso se utilizará guantes de cuero o badana. -Colocar los paquetes uno seguido del otro y siempre dejando espacios para que el vapor penetre entre ellos. Si fuera necesario apilar paquetes, colocarlos en forma cruzada o alternada y así sucesivamente hasta llenar la canastilla hasta 3/4 de la capacidad.
5. Conectar y encender equipo	Cables rotos, expuestos, en mal estado. -Tomacorrientes en mal estado. -Contacto con puntos energizados.	-Electrocución, quemaduras, paro cardíaco, asfixias.	-Para conectar el equipo al tomacorriente se debe verificar que el enchufe, cables y tomacorrientes se encuentren en buenas condiciones. (no deben estar quebrados ni con cables pelados). Deben existir además inspecciones periódicas a los equipos e instalaciones eléctricas para su respectivo mantenimiento. -Coger los enchufes y tomacorrientes por las superficies aisladas, cuidando de no tener contacto con las partes metalizadas.
6. Esterilización			-Dar inicio a la programación de esterilización y esperar hasta que el equipo dé el aviso de finalización.
7. Retiro de materiales e instrumentos esterilizados	Contacto con materiales y superficies calientes	-Quemaduras	- Al abrir la puerta observe la salida de vapor, mantenga una distancia prudente entre el cuerpo y el equipo. -Retirar la canastilla usando guantes de cuero, badana y tenazas. -Tener cuidado en todo momento no hacer contacto directo con superficies ni líquidos calientes.
8. Orden y limpieza			
<b>V. RESTRICCIONES:</b> La actividad será suspendida cuando:			
- Los Estudiantes de la práctica no cuenten con EPPs.		-No se cuente con autorización para uso del equipo	
- Los Estudiantes no cuenten con personal que supervise la práctica.		-Las medidas de seguridad no son las adecuadas.	



*Handwritten signature*





# OTRO DOCUMENTO

CÓDIGO: PDI-OD-95  
 FECHA: Marzo - 2022  
 VERSIÓN: 01  
 PÁGINA: 63 DE 75



## PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA

	<b>PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO</b> <b>USO DE CENTRÍFUGA</b>	CÓDIGO: -UNCA
		FECHA: SETIEMBRE 2021
		VERSIÓN : 01      PAGINA: 1 de 2

<b>I. PERSONAL:</b>			
a. Jefe de laboratorios / Asistente de Laboratorios	c. Estudiantes y otros usuarios		
b. Docentes			
<b>II. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:</b>			
a. Guantes de nitrilo	c. Zapato cerrado		
b. Lentes de seguridad (si fuera indicado)	d. Mandil		
<b>III. EQUIPO / MATERIALES:</b>			
a. Centrífuga	c. Herramientas para cambio de rotor		
b. Tubos de ensayo de vidrio o plástico	d. Balanza de precisión		
<b>IV. PROCEDIMIENTO:</b>			
<b>PASOS OPERACIONALES</b>	<b>PELIGRO</b>	<b>RIESGO</b>	<b>MEDIDAS DE CONTROL</b>
1. Traslado de equipo y materiales al lugar de trabajo:	-Caída del equipo durante su traslado por el peso del equipo. -Piso resbaladizo o con obstáculos. -Inestabilidad y/o caída de la centrífuga en caso de apoyarse sobre superficie inadecuada. -Material roto o mal tapado.	-Resbalones, tropezones, golpes, contusiones, raspones. -Atricciones -Cortes, heridas.	-Verificar que la superficie donde se colocará el equipo sea estable, resistente al peso del equipo, y en condiciones adecuadas. -Revisar que el piso por donde se realizará el transporte, no se encuentre con obstáculos ni resbaladizo. -Realizar el levantamiento del equipo (mínimo entre 2 personas) siguiendo el Procedimiento de Manual de Cargas. -Verificar que los materiales a trasladar se encuentren limpios y en buenas condiciones.
2. Conectar y encender el equipo	-Cables rotos, expuestos, en mal estado. -Tomacorrientes en mal estado. -Contacto con puntos energizados.	-Electrocución, quemaduras, paro cardíaco, asfixias.	-Para conectar el equipo al tomacorriente se debe verificar que el enchufe, cables y tomacorrientes se encuentren en buenas condiciones. (no deben estar quebrados ni con cables pelados). Deben existir además inspecciones periódicas a los equipos e instalaciones eléctricas para su respectivo mantenimiento. -Coger los enchufes y tomacorrientes por las superficies aisladas, cuidando de no tener contacto con las partes metalizadas.
3. Preparación de material a centrifugar y pesaje de tubos.	-Contacto con superficies punzocortantes por material de vidrio en mal estado. -Contacto con sustancias biocontaminantes.	-Cortes, heridas, hemorragias. -Contaminación, infecciones.	-Revisar que todo el material con el que se va a trabajar se encuentre en buen estado (sin quebraduras ni rajaduras), sobre todo el material de vidrio. -Utilizar guantes de nitrilo durante toda la tarea en caso se trabaje con sustancias biológicas. -Pesar los tubos a centrifugar, que no existan diferencias de peso de más de 0.1g entre ellos.
4. Colocación de tubos en centrífuga	-Inestabilidad de rotor. -Rotura de rotor o tubos. -Generación de proyectiles. -Contacto con sustancias biocontaminantes.	-Daños al equipo. -Impacto de proyectiles en rostro u otras partes del cuerpo. -Contaminación, infecciones.	-Revisar que el rotor se encuentre bien ajustado. - Colocar los tubos de modo que los pesos se encuentren equilibrados lo más simétricamente posible, para evitar así desequilibrio del rotor en funcionamiento. -Los tubos con material biológicos estarán tapados.
5. Centrifugado	-Inestabilidad de rotor. -Rotura de rotor o tubos. -Generación de proyectiles.	-Daños al equipo. -Impacto de proyectiles en rostro u ojos.	-Revisar que la tapa de la centrífuga esté bien cerrada antes de iniciar el centrifugado.
6. Retiro de tubos de la centrífuga	-Material roto -Sobreexposición a sustancias biocontaminantes.	-Cortes, heridas, hemorragias. -Contaminación, infecciones.	-Antes de retirar el material, revisar que no se encuentre quebrado. -Usar guantes de nitrilo para evitar tener contacto con sustancias biocontaminantes.
7. Apagar y desconectar equipo	-Contacto con puntos energizados.	-Electrocución, quemaduras, paro cardíaco, asfixias.	-Coger los enchufes y tomacorrientes por las superficies aisladas, cuidando de no tener contacto con las partes metalizadas.
8. Orden y limpieza	-Piso resbaladizo o con obstáculos.	-Caídas a nivel, golpes, contusiones	-Cuidar de dejar todo el lugar de trabajo limpio y ordenado, sin obstáculos en piso o corredores. -Dejar todas las superficies limpias y secas (limpiar finalmente con alcohol de 70°).
<b>V. RESTRICCIONES:</b> La actividad será suspendida cuando:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los cables, enchufes o tomacorrientes a utilizar estén rotos, con cables pelados o en otras malas condiciones.</li> <li>- Los estudiantes o usuarios no cuenten con los EPP requeridos.</li> <li>- Los estudiantes no cuenten con personal que supervise la práctica.</li> <li>- No se cuente con autorización para la utilización del equipo.</li> <li>- No se pueda adoptar algunas de las medidas de control aquí estipuladas.</li> </ul>			



*Jan*



**OTRO DOCUMENTO**

---

**PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA**

CÓDIGO:	PDI-OD-95
FECHA:	Marzo - 2022
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	<b>64 DE 75</b>



	<b>PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO</b>	CÓDIGO:	-UNCA
	<b>USO DE COCINILLA ELÉCTRICA</b>	FECHA:	OCTUBRE 2021
		VERSIÓN : 01	PAGINA: <b>1 de 3</b>

<b>I. PERSONAL:</b>			
a. Jefes de laboratorio / Asistente de Laboratorio			c. Estudiantes / Otros usuarios
b. Docentes			
<b>II. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:</b>			
a. Mandil			d. Lentes de seguridad (de ser indicado)
b. Zapato cerrado			e. Guantes de cuero o badana u otro resistente a altas temperaturas.
c. Cubre boca o mascarilla			
<b>III. EQUIPO / MATERIALES:</b>			
a. Cocinilla eléctrica			c. Pinzas o tenazas
b. Recipiente para calentar (vasos, matraces, pomos, frascos, etc.)			
<b>IV. PROCEDIMIENTO:</b>			
<b>PASOS OPERACIONALES</b>	<b>PELIGRO</b>	<b>RIESGO</b>	<b>MEDIDAS DE CONTROL</b>
1. Traslado de equipo y materiales al lugar de trabajo.	-Piso resbaladizo o con obstáculos.	-Resbalones, tropezones, golpes, raspones por caídas a nivel.	- Revisar que el piso por donde se transitará, no se encuentre con obstáculos, mojado, ni esté resbaladizo.
2. Preparación de material	-Exposición a sustancias químicas corrosivas, tóxicas, e irritantes.  -Exposición a sustancias biológicas con potencial biocontaminante.  -Material de vidrio en mal estado (roto o rajado)	-Contacto o inhalación de sustancias o gases tóxicos, irritantes o corrosivos.  -Contacto o inhalación de sustancias biocontaminantes.  -Cortes, heridas, hemorragias.	-Conocer las sustancias con las que se trabajará (En caso de sustancias químicas, conocer y tener la hoja MSDS durante toda la actividad). -Utilizar guantes de nitrilo en todo momento. -Revisar que los recipientes para calentar se encuentren limpios y libres de materiales extraños. -Rotular o etiquetar los envases a utilizar.
3. Conectar y encender equipo	-Cables rotos, expuestos, en mal estado. -Tomacorrientes en mal estado. -Contacto con puntos energizados	-Electrocución, quemaduras, paro cardíaco, asfixias.	-Para conectar el equipo al tomacorriente se debe verificar que el enchufe, cables y tomacorrientes se encuentren en buenas condiciones. (no deben estar quebrados ni con cables pelados). Deben existir además inspecciones periódicas al equipo e instalaciones eléctricas para su respectivo mantenimiento. -Coger los enchufes y tomacorrientes por las superficies aisladas, cuidando de no tener contacto con las partes metalizadas. -Evitar equipos eléctricos y materiales inflamables a menos de 2 m. de la cocinilla.
4. Colocación y calentamiento de material en hornilla del equipo	-Superficie caliente -Vapores calientes -Derrame de líquidos calientes.	-Contacto con superficies calientes -Quemaduras de rostro u otras partes del cuerpo expuestas a vapores calientes. -Quemaduras por contacto con líquidos calientes.	-Colocar el material sobre las hornillas cuidando que queden asentados de manera firme. Considerar 10 kg como peso máximo sobre las hornillas. -No tapar completamente los envases o frascos, dejando un escape para vapores y evitar presiones internas. -Evitar exposición de rostro u otras partes del cuerpo sobre línea de escape de vapores generados. Uso de lentes de seguridad -Evitar contacto con superficie caliente; señalización de advertencia. -Evitar otros equipos eléctricos y materiales inflamables a menos de 2 m. de la cocinilla.
5. Retiro de material	-Superficie caliente de cocinilla. -Material caliente	-Contacto con superficie caliente de cocinilla. -Contacto material caliente	-Evitar contacto con superficie caliente; señalización de advertencia. -Uso de guantes aislantes de calor para retiro de material. Ayudarse de pinzas o tenazas si fuera posible.
<b>V. RESTRICCIONES:</b> La actividad será suspendida cuando:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los estudiantes de la práctica o usuarios no cuenten con los EPP apropiados para la actividad.</li> <li>- Los estudiantes no cuenten con personal que supervise la práctica.</li> <li>- No se cuente con autorización para la utilización del equipo.</li> <li>- El equipo se encuentra en malas condiciones.</li> <li>- Si no se puede adoptar algunas de las medidas de control aquí mencionadas.</li> </ul>			



*Jan*



### OTRO DOCUMENTO

CÓDIGO: PDI-OD-95  
 FECHA: Marzo - 2022  
 VERSIÓN: 01  
 PÁGINA: 65 DE 75



### PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-PR-35	
		FECHA:	Septiembre-2021	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	1 DE 2	
<b>PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PROCEDIMIENTO PARA USO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LABORATORIOS Y TALLERES</b>				

- I. PERSONAL:**
  - a. Docente
  - b. Jefe y Asistente de laboratorio
  - c. Estudiantes
  - d. Usuarios
- II. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:**
  - a. Zapatos de seguridad.
- III. EQUIPO / MATERIALES:**
  - a. Utilización de interruptor para luminarias.
  - b. Utilización de tomacorrientes para funcionamiento directo de equipos.
  - c. Utilización de tomacorriente permanente para equipos
  - d. Utilización de tableros eléctricos y llave térmica para equipos con consumo de energía más de 1000 w
  - e. Utilización de tomacorrientes para cargar equipos

<b>IV. PROCEDIMIENTO:</b>			
<b>PASOS OPERACIONALES (Indicar todos los pasos posibles)</b>	<b>PELIGRO (Indicar todos los peligros posibles por paso)</b>	<b>RIESGO (Indicar todos los riesgos posibles por peligro)</b>	<b>MEDIDAS DE CONTROL</b>
1. Utilización de interruptor para luminarias.	- Encender y apagar con manos o pies mojados	- Descarga eléctrica	- Charla de 5 minutos, - Contar con procedimiento de trabajo seguro.
	- Suministro de Corrientes a normal	- Subidas y bajadas de tensión	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
	- Manipulación de interruptor en mal estado	- Corto circuito	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
2. Utilización de tomacorrientes para funcionamiento directo de equipos	- Conectar y desconectar con manos o pies mojados	- Descarga eléctrica	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
	- Suministro de corriente anormal	- Subidas y bajadas de tensión	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
	- Manipulación de tomacorriente en mal estado	- Corto circuito	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
3. Utilización de tomacorriente permanente para equipos.	- Conectar y desconectar con manos o pies mojados	- Descarga eléctrica	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
	- Suministro de corriente anormal	- Subidas y bajadas de tensión	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
	- Tomacorriente en mal estado	- Corto circuito	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
4. Utilización de tableros eléctricos y llave térmica para equipos con consumo de energía más de 1000 w	- Subir o bajar llave térmica con manos o pies mojados	- Descarga eléctrica	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
	- Suministro de corriente anormal	- Subidas y bajadas de tensión	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
	- Llave térmica en mal estado	- Corto circuito	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
5. Utilización de tomacorrientes para cargar equipos.	- Conectar y desconectar con manos o pies mojados	- Descarga eléctrica	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
	- Suministro de corriente anormal	- Subidas y bajadas de tensión	- Contar con procedimiento de trabajo seguro
	- Tomacorriente en mal estado	- Corto circuito	- Contar con procedimiento de trabajo seguro

- V. RESTRICCIONES:** La actividad será suspendida cuando:
- Los usuarios no cuenten con las medidas de seguridad necesarias
  - Se utilizarán extensiones sin toma de tierra (de dos orificios).
  - No se use tomacorrientes de tres receptáculos para enchufes de tres patas.
  - Existan instalaciones de conductores eléctricos cercanos a calentadores y otras fuentes de calor.

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
Ing. Roger Baltazar Flores	COMITÉ DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, QUÍMICA Y FÍSICA	COMITÉ DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, QUÍMICA Y FÍSICA
Septiembre-2021	Septiembre-2021	Septiembre-2021

**La impresión o copia adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"**





OTRO DOCUMENTO

CÓDIGO: PDI-OD-95
FECHA: Marzo - 2022
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 66 DE 75





PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA

Table with 2 columns: Title (PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO, USO DE MICRÓTOMO DE MANO) and Metadata (CÓDIGO: -UNCA, FECHA: SETIEMBRE 2021, VERSIÓN: 01, PAGINA: 1 de 2)

Main protocol table with sections I (PERSONAL), II (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL), III (EQUIPO / MATERIALES), IV (PROCEDIMIENTO: PASOS OPERACIONALES, PELIGRO, RIESGO, MEDIDAS DE CONTROL), and V (RESTRICCIONES)





Handwritten signature

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95		
			FECHA:		Marzo - 2022
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGIA</b>		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		67 DE 75

**Anexo N° 5. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC) del Laboratorio de Biología.**

		<b>IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE LABORATORIO DE BIOLÓGIA Y BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA</b>										CÓDIGO: PDI-RE-53 VERSIÓN: 01 FECHA: AGOSTO 2021				
		N°	Actividad	Tarea	Peligro	Riesgo	Con exposición (Lesión, enfermedad, daño)	Riesgo (P x IB)	Nivel de Riesgo	Riesgo Biogénico	Medidas de Control					Riesgo (P x IB)
Eliminación	Substitución										Ingeniería	Administrativa	EPP			
1	Uso de equipos, luminarias, accesorios eléctricos e instalación eléctrica	Encendido/apagado e luminarias	Manipulación de interruptores con manos o pies mojados	Descarga eléctrica/electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	M	SI				Inducción de seguridad. Charlas sobre usos de equipos eléctricos, accesorios, luminarias e instalaciones eléctricas. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA, brigada de emergencias.	S	TO	NO	
			Interruptores en mal estado	electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	M	SI				Inspección diaria. Inducción de seguridad. Inspección y manejo de luminarias y sistemas eléctricos. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA, brigadas de emergencia.	S	TO	NO	
			Manipulación de accesorios eléctricos con manos o pies mojados	electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	M	SI				Inspección diaria. Inducción de seguridad. Charlas sobre usos de equipos eléctricos, accesorios, luminarias e instalaciones e. Plan de respuesta ante emergencias eléctricas. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA.	S	TO	NO	
			Cables pelados o quemados	electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	27	IT	SI				Inspección diaria. Inducción de seguridad a ingresantes. Inspección de luminarias y sistemas eléctricos. Plan de respuesta ante accidentes. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA.	S	TO	NO	
			Accesorios eléctricos viejos o en mal estado	electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	27	IT	SI				Inspección diaria. Inducción de seguridad. Inspección de luminarias y sistemas eléctricos. Plan de respuesta ante emergencias eléctricas. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA.	S	TO	NO	
			Sube carga de transformadores y/o extensiones eléctricas	haznidos, electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	M	SI			Exibir habilitado en el ambiente. Mantar linkages	Inducción de seguridad. Charla de uso de equipos eléctricos, accesorios, luminarias e instalaciones eléctricas. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA. Brigada de emergencia.	S	TO	NO	
		Uso de accesorios eléctricos: (bomberos, enchufes, extensiones eléctricas)	Trabajos de actividades	Es letal, laboral, ansiedad, hace tomar medidas por altos o en actividades laborales.	11	MO	SI			Sistema de puesta a tierra. Es tabilizaciones de voltaje y equipos UPS.				S	TO	NO
			Fluctuaciones eléctricas	Daño a equipos por sobrecarga de tensiones eléctricas	20	M	SI			Sistema de puesta a tierra. Es tabilizaciones de voltaje y equipos UPS.				S	TO	NO
			Generación de chispas eléctricas	Arreglo de incendios, haznidos, explosiones	Quemaduras, asfixias, lesiones secundarias, muerte	24	M	SI			Exibir habilitado en el ambiente. Mantar linkages	Inspecciones diarias. Procedimiento de manejo de Sustancias Peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de emergencias. Capacitación en primeros auxilios. Bolequinde emergencia.	S	TO	NO	
			Conexión de conexión o encendido con manos o pies mojados	Electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, shock, fibrilación ventricular, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	M	SI				Inspección diaria. Inducción de seguridad. Charlas sobre usos de equipos eléctricos, accesorios, luminarias e instalaciones e. Plan de respuesta ante emergencias eléctricas. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA.	S	TO	NO	
			Conexión de conexión y uso de dispositivos eléctricos en manos (computadores de celulares, tabletas, laptops, Jamparas portátiles, tableta, radios, entre otros)	electrocución	lesiones por electrización, quemaduras, shock, fibrilación ventricular, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	M	SI				Inducción de seguridad. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal de la UNCA. Brigada de primeros auxilios	S	TO	NO	
			Cables, enchufes o conexiones en mal estado	Subidas y bajadas de tensión	lesiones por electrización, quemaduras, shock, fibrilación ventricular, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	M	SI				Inspección diaria. Inducción de seguridad. Inspección periódica de equipos. Inspección de luminarias y sistemas eléctricos. Plan de respuesta ante emergencias eléctricas. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA.	S	TO	NO	

**La impresión o copia adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"**

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95		
		FECHA:	Marzo - 2022		
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA</b>		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		<b>68 DE 75</b>

2	Uso del ambiente del Laboratorio	Desarrollo de clases prácticas / organización de laboratorio / Inspecciones / visitas y otros.	Piso resbaladizo / en mal estado / resquebrajados	Resbalones, tropezones, caídas a nivel.	Golpes, Contusiones, Fracturas, Hematomas	16	MO	SI			Restricciones de tránsito, Cintas antideslizantes	Señalética, inspecciones diarias.		6	TO	NO
			Iluminación inadecuada del ambiente	Ambientes con poca iluminación o exposición a altas luminancias	Fatiga visual, cansancio, inflamación ocular, enrojecimiento e irritación ocular, dolor de cabeza, estrés.	11	MO	SI			persianas, cortinas, Lámparas, Número de ventanas	Utilizar en lo posible luz natural. Evitar deslumbramientos y proyección directa de luz solar. Fuentes luminosas suficientes y adecuadas. Inspección a luminarias. Mantenimiento de luminarias. Limpieza de ventanas.		6	TO	NO
			Desorden, objetos en el suelo	Tropezones, caídas a nivel	Luxaciones, golpe, hematomas	16	MO	SI				Orden y limpieza, inspecciones diarias. Rotulado de equipos. Señalización en caso se requiera. Inducción de seguridad		8	TO	NO
			Posturas inadecuadas	Movimiento repetitivos, posturas prolongadas, movilidad restringida.	Fatiga muscular, Mialgias, Contracturas, Transtornos Musculo Esqueléticos (TME).	18	M	SI			altura adecuada de mesa y bancos. Bancos de reposo disponibles.	Evitar malas posturas. Ambientes amplios de trabajo. Cambios posturales. Pausas activas. Charlas sobre ergonomía		8	TO	NO
			Material particulado	sobreexposición a partículas sólidas (principalmente polvo)	Alergias respiratorias, irritación en vías respiratorias, irritación ocular, asfias,.	20	M	SI				Constante limpieza del laboratorio y equipos. Ventilación del ambiente. Inducción de seguridad. Inspección a ambiente y equipos.	Uso de Tapabocas, de ser necesario.	8	TO	NO
3	Traslado de muebles, materiales y/o equipos	Traslado de muebles, materiales y/o equipos	Caída del mueble o equipo en zonas corporales	Caída del mueble o equipo en zonas corporales	Golpes, lesiones, hematomas, atrociaciones.	16	MO	SI			Utilizar medios de transporte, de ser posible.	Procedimiento de levantamiento manual de cargas. Inducción de seguridad. Peso max de 25 Kg/persona. Levantamiento de carga entre 2 o más personas. Evitar exponer partes del cuerpo bajo cargas suspendidas	EPP básico	8	TO	NO
			Piso resbaladizo, a desnivel, u objetos en piso	Caídas a nivel, resbalones, tropezones.	golpes, hematomas, lesiones.	20	M	SI			Cintas antideslizantes.	Orden y limpieza, inspecciones diarias. Rotulado de equipos. Señalización en caso se requiera. Inducción de seguridad		8	TO	NO
			Levantamiento de cargas excesivas	Levantamiento manual inadecuado de cargas, sobreesfuerzos	Fatiga muscular, Contracturas, Transtornos Musculo Esqueléticos (TME), Hernias	16	MO	SI				Procedimiento de levantamiento manual de cargas. Inducción de seguridad. Peso max de 25 Kg/persona. Levantamiento de carga entre 2 o más personas. Posturas adecuadas. Evitar sobreesfuerzos. Charlas sobre ergonomía.		5	TO	NO
			Posturas inadecuadas	Movimiento repetitivos, posturas prolongadas, movilidad restringida.	Fatiga muscular, Mialgias, Contracturas, Transtornos Musculo Esqueléticos (TME).	9	MO	SI				Evitar malas posturas. Ambientes amplios de trabajo. Cambios posturales. Pausas activas. Charlas sobre ergonomía		5	TO	NO

**La impresión o copia adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"**





# OTRO DOCUMENTO

## PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA

CÓDIGO: PDI-OD-95  
 FECHA: Marzo - 2022  
 VERSIÓN: 01  
 PÁGINA: 69 DE 75



*Jan*

4. Manipulación de reactivos químicos	Recepción de reactivos químicos.	Etiquetas o tapas en mal estado	Sobree exposición a agentes biológicos, irritantes o corrosivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	27	IT	SI	0 Uchabuseos	Inspección diaria. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Procedimiento Uso correcto de EPP.	EPP básico (guantes, mascarilla) EPP específico (guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial)	5	T	NO
		Manipulación inadecuada de reactivos químicos.	Sobree exposición a agentes biológicos, irritantes o corrosivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	27	IT	SI	0 Uchabuseos	Inspección diaria. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Procedimiento Uso correcto de EPP.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial	5	T	NO
	Tratado de reactivos químicos	Piso resbaladizo en mal estado. Resquebrajados	Resbalones, golpe Jones, caídas a nivel.	Golpes. Contusiones. Fracturas. Hematomas	16	NO	SI	Res Mediciones de e hanello. O lentes antidesbrantes	Señalética. Inspecciones diarias.		5	T	NO
		Redipienles, enusos o tapas en mal estado	Sobree exposición a agentes biológicos, irritantes o corrosivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	30	IT	SI	0 Uchabuseos	Conocer todo MSB del producto. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de primeros auxilios. Procedimiento Uso correcto de EPP.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial.	5	T	NO
		Manipulación inadecuada de reactivos químicos.	Sobree exposición a agentes biológicos, irritantes o corrosivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	12	NA	SI	0 Uchabuseos	Inspección de seguridad. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Conocer todo MSB del producto. Procedimiento Uso correcto de EPP.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial.	5	T	NO
		Redipienles, enusos o tapas en mal estado	Sobree exposición a agentes biológicos, irritantes o corrosivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	15	NA	SI	0 Uchabuseos	Inspección de seguridad. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Hojas MSB del producto.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial.	6	T	NO
	Almacenamiento de reactivos químicos.	Etiquetas no rotuladas	Sobree exposición a agentes biológicos, irritantes o corrosivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	30	IT	SI	0 Uchabuseos	Rotulación adecuada de reactivos. No usar reactivos sin rotular. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Procedimiento Uso correcto de EPP. Inspección de manejo de MATP EL.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial según como sea el caso.	5	T	NO
		Levanamiento de cargas	Sobree esfuerzos por levamiento de cargas	Estrambientes, hernias, dislocaciones, traumatismos lumbares, fatiga muscular.	15	NA	SI	SI	Peso máximo de carga 25kg. No usar ayudas. No realizar a diámetro. Procedimiento de manejo adecuado de cargas		5	T	NO
		Ambientes inadecuados	Temperaturas y/o presiones que provoquen incomodidad.	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	30	IT	SI	SI		Inspección de MATP EL. Señalización de almacenamiento de reactivos. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial según como sea el caso.	5	T	NO
		Redipienles, enusos o tapas en mal estado	Sobree exposición a agentes biológicos, irritantes o corrosivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	15	NA	SI	0 Uchabuseos	Inspección de seguridad. Procedimiento de manejo de sus bandas peligrosas. Conocer todo MSB. Hojas MSB accesibles. Inspección de manejo de MATP EL.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial según como sea el caso.	5	T	NO
	Almacén de reactivos de reactivos químicos.	Etiquetas no rotuladas	Sobree exposición a agentes biológicos, irritantes o corrosivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	27	IT	SI	0 Uchabuseos	Rotulación adecuada de reactivos. No usar reactivos sin rotular. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Procedimiento Uso correcto de EPP. Inspección de manejo de MATP EL.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial según como sea el caso.	5	T	NO
		Almacenamiento inadecuado	Derivados de agentes biológicos, explosivos y reactivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	27	IT	SI	0 Uchabuseos	Procedimiento Uso correcto de MATP EL. Inspección de manejo de almacenamiento de reactivos. Hojas MSB accesibles	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial según como sea el caso.	5	T	NO
		Pasillos inadecuados	Mantenimiento regular de pasillos, pasillos obstruidos, moquedad de los pisos.	Fatiga muscular. Molestias. Contusiones	14	NO	SI	SI	Señalización de estado de pasillos y banquetas. Bancos de reposo disponibles. Charlas sobre ergonomía		4	T	NO
	Dilución de reactivos químicos	Manipulación inadecuada en mal estado	Sobree exposición a agentes biológicos, irritantes o corrosivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	15	NA	SI	0 Uchabuseos	Inspección de seguridad. Inspección de materiales e instrumentos.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial según como sea el caso.	5	T	NO
		Generación de vapores peligrosos	Sobree exposición a vapores biológicos, irritantes	Irritación de las vías respiratorias, ojos, irritación, Asfma.	15	NA	SI	0 Uchabuseos	Conocer todo MSB del producto. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de primeros auxilios. Procedimiento Uso correcto de EPP.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial según como sea el caso.	5	T	NO
		Uso inadecuado de reactivos	Sobree exposición a reactivos químicos, irritantes o corrosivos	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas o vías respiratorias. Asfma. Alergias	27	IT	SI	0 Uchabuseos	Conocer todo MSB del producto. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de primeros auxilios. Procedimiento Uso correcto de EPP.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial según como sea el caso.	5	T	NO
	Eliminación de residuos de diluciones	Generación de vapores peligrosos	Sobree exposición a vapores biológicos, irritantes	Irritación de las vías respiratorias, ojos, irritación, Asfma.	20	NA	SI	0 Uchabuseos	Conocer todo MSB del producto. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de primeros auxilios. Procedimiento Uso correcto de EPP.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial según como sea el caso.	5	T	NO
		Sus bandas biológicas, irritantes, corrosivas	Sobree exposición a sus bandas biológicas, irritantes o corrosivas	Quemaduras. Irritación en piel, mucosas.	27	IT	SI	0 Uchabuseos	Conocer todo MSB del producto. Capacidad de manejo de sus bandas peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de primeros auxilios. Procedimiento Uso correcto de EPP.	EPP básico. Uso de guantes, mascarilla o gafas de seguridad, lentes de seguridad, protector facial según como sea el caso.	5	T	NO

La impresión o copia adquiere el estado de **"DOCUMENTO NO CONTROLADO"**



OTRO DOCUMENTO

PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA

CÓDIGO: PDI-OD-95  
 FECHA: Marzo - 2022  
 VERSIÓN: 01  
 PÁGINA: 70 DE 75



*Jan*

Endubar y mantener equipo	Cables y/o interruptores en mal estado	electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	N	SI			hepe odón diaria. Inducción de seguridad. hepe odón de luminarias y sistemas eléctricos. Plan de respuza ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal U. N. C. A. Brigadas de emergencia.		5	70	NO	
	Generación de chispas eléctricas	Amago de incendios. Inicializos, explosiones	Quemaduras, asfixias, lesiones secundarias, muerte	24	N	SI		Ex. linko habilitado en el ambiente. Mantos inulugos	hepe odones diarias. Procedimiento de manejo de sus lanchas. Peligrosos. Plan de respuza ante emergencias. Brigadas de emergencia. Capacitación en primeros auxilios. Bolequid de emergencia.		5	70	NO	
	Mantipulación con manos o pies mojadas	electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	N	SI			hepe odón diaria. Inducción de seguridad. Plan de respuza ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal U. N. C. A. Brigadas de emergencia.		5	70	NO	
Uso de Autoclave	Estabilidad del equipo	Caída del equipo	atlocaciones, golpes, contusiones	16	MO	SI		Supervisión a mesas de eouadas	hepe odón diaria. hepe odones periódicos de equipos. Procedimiento para uso de autoclave. Capacitación en el uso de equipo. Inducción de seguridad		5	70	NO	
	Colocación de material a esterilizar	Contaminación con superñides punto caliente s (mal estado de un rollo, metales contusos)	contus, lesiones cutáneas, hemorragias, infecciones cutáneas, entre otros.	16	MO	SI			hepe odón diaria. Inducción de seguridad. hepe odones periódicos de materiales e instrumentos de lab de biología	EPP básico. Uso de guantes (de indicarse).	5	70	NO	
	Sus lanchas biocontaminantes	Contaminación de piezas muocoras con sus lanchas biocontaminantes, infecciones.	Reacciones cutáneas, alergias, atlocaciones respiratorias, meningitis e infecciones, biocontaminación general.	16	N	SI			Procedimiento para uso de autoclave (P. P. U.). Procedimiento de respuza Estándar (P. P. E.). Capacitación en el uso de equipo. Inducción de seguridad.	EPP básico. Uso de EPP espe cial (guantes, lentes de seguridad), si corresponde.	5	70	NO	
	Exposición a altas temperaturas	Contaminación con superñides calientes	quemaduras cutáneas	16	N	SI		Uso de pinzas o tenazas	Procedimiento para uso de autoclave (P. P. U.). Procedimiento de respuza Estándar (P. P. E.). Capacitación en el uso de equipo. Inducción de seguridad.	EPP básico. Uso de EPP espe cial (guantes, lentes de seguridad), si corresponde.	5	70	NO	
	Equipos y material con altas temperaturas	Contaminación con superñides calientes	quemaduras cutáneas en tercer grado	16	N	SI			Procedimiento para uso de autoclave (P. P. U.). Procedimiento de respuza Estándar (P. P. E.). Capacitación en el uso de equipo. Inducción de seguridad.	EPP básico. Uso de EPP espe cial (guantes, lentes de seguridad), si corresponde.	5	70	NO	
Retiro de material esterilizado	Equipos con alta presión interna	Impacto de vapores calientes en rostro o manos	quemaduras en tercer grado	16	N	SI		Valvula de presión bloqueada	Procedimiento para uso de autoclave (P. P. U.). Procedimiento de respuza Estándar (P. P. E.). Capacitación en el uso de equipo. Inducción de seguridad. Mantimiento preventivo. Inspección periódica de equipos.	EPP básico. Uso de EPP espe cial (lentes de seguridad), si corresponde.	5	70	NO	
	Material con superñides punto caliente	Contaminación con superñides punto caliente s	lesiones cutáneas, hemorragias, infecciones cutáneas, entre otros.	16	MO	SI			Inducción de seguridad. hepe odones periódicos de instrumentos y equipos	EPP básico. Uso de EPP espe cial (guantes)	5	70	NO	
	Cables y/o interruptores en mal estado	electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	N	SI			hepe odón diaria. Inducción de seguridad. hepe odón de luminarias y sistemas eléctricos. Plan de respuza ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal U. N. C. A. Brigadas de emergencia.		5	70	NO	
Uso de Inocubadora	Endubar y mantener equipo	Generación de chispas eléctricas	Amago de incendios. Inicializos, explosiones	24	N	SI		Ex. linko habilitado en el ambiente. Mantos inulugos	hepe odones diarias. Bolequid de seguridad. Procedimiento de manejo de sus lanchas Peligrosos. Plan de respuza ante emergencias. Brigadas de emergencia. Capacitación en primeros auxilios. Bolequid de emergencia.		5	70	NO	
	Colocación y retiro de material	Mantipulación con manos o pies mojadas	electrocución	quemaduras, lesiones por electrización, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	N	SI			hepe odón diaria. Inducción de seguridad. Plan de respuza ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal U. N. C. A. Brigadas de emergencia.		5	70	NO
		Equipos con superñides o partes en mal estado	Contaminación con superñides de vidrio roto y/o metales biocontaminantes	Contus, heridas, hemorragias	14	MO	SI			hepe odones diarias. hepe odones periódicos de equipo. Programa de mantenimiento preventivo. Inducción de seguridad.	EPP básico. Uso de EPP (guantes, lentes de seguridad).	5	70	NO
		Instrumentos o materiales rotos y en mal estado.	Contaminación con superñides punto caliente s	Contus, heridas, hemorragias	16	MO	SI		Sus litud de materiales rotos o rotados	hepe odón diaria. Inducción de seguridad. hepe odones periódicos de materiales e instrumentos de lab de biología	EPP básico. Inducase).	5	70	NO
	Utilización del equipo	Sus lanchas biocontaminantes	Contaminación de piezas muocoras con sus lanchas biocontaminantes	Reacciones cutáneas, alergias, atlocaciones respiratorias, meningitis e infecciones, biocontaminación general.	16	MO	SI			Procedimiento para uso de inocubadora. Capacitación en el uso de equipo. Inducción de seguridad.	Uso adecuado de EPP (guantes, tapabocas, lentes, mascaril).	5	70	NO
		Estabilidad del equipo o superñides inestable	Caída del equipo o sobrepones contusos	atlocaciones, golpes, contusiones, hematomas.	16	MO	SI		Supervisión a mesas de eouadas	hepe odón diaria. hepe odones periódicos de equipos. Capacitación en el uso de equipo. Inducción de seguridad	EPP básico	5	70	NO



OTRO DOCUMENTO

PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGÍA

CÓDIGO:

PDI-OD-95

FECHA:

Marzo - 2022

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

71 DE 75



Uso de microscopio de mano	Coma de muestras	Forma de muestra	Material biocombinado	Tratado de microscopio	Enchufar y encender equipo	Colocación y retiro de material	Uso de centrifuga	Centrifugado	Uso de cocinita eléctrica						
		Puerta inadecuada	Mala o puntada por una presión inadecuada de los dedos	Lesiones musculares quemaduras, fatiga muscular, contusiones	10	IM	91		otras adecuadas de mesas y bancos	Evitar puntadas inadecuadas. Cambios posturales. Pausas activas. Charlas 5 min sobre ergonomía					
		Filo de cuchilla	Contacto del filo de la cuchilla con piel mano u otras partes del cuerpo	Quemaduras, lesiones, hemorragias, infecciones	27	II	91		Guantes de seguridad	No exponer partes del cuerpo al filo de la cuchilla. Previamente para uso de microscopio de mano inducción de seguridad. Charlas de 5 minutos					
		Material biocombinado	Contacto de piel o mucosas con materiales biocombinados	Reacciones cutáneas, alergias, infecciones respiratorias, enfermedades e infecciones, biocombinación engañosa	10	IM	91			Procedimiento para uso de incubadora. Capacitación en el uso del equipo. Inducción de seguridad. Charlas de 5 minutos					
		Filo mojado o resbaladizo	Caida a nivel	Dolores, contusiones, quemaduras, fracturas	27	II	91			Señalética					
		Cables y/o interruptores en mal estado	Electrocución	quemaduras, lesiones por electrificación, asfixias, paro cardíaco, paro respiratorio, muerte	24	IM	91			Inspección de sitio. Inducción de seguridad. Inspección de luminarias y sistemas eléctricos. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA. Brigada de emergencia					
		Generación de chispas eléctricas	Arreglo de incendios, incendios, explosiones	quemaduras, asfixias, lesiones secundarias, muerte	24	IM	91			Evitar habilidad en el ambiente. Mantener Intufo					
		Manipulación con manos o pies mojadas	Electrocución	quemaduras, lesiones por electrificación, asfixias, paro cardíaco, paro respiratorio, muerte	24	IM	91								
		Materiales roto o en mal estado	Contacto con filos de vidrios y/o metales punzocortantes	Quemaduras, lesiones, hemorragias	10	IM	91			Inspección de materiales roto o rajado	Inspección de sitio. Inducción de seguridad. Inspección de materiales y sistemas eléctricos (Inmateriales de lab de biología)				
		Sustancias biocombinadas	Contacto de piel o mucosas con sustancias biocombinadas	Reacciones cutáneas, alergias, infecciones respiratorias, enfermedades e infecciones, biocombinación engañosa	10	IM	91			Procedimiento para uso de incubadora. Capacitación en el uso del equipo. Inducción de seguridad. Charlas de 5 minutos					
		Ronra del rotor	Impacto de proyectiles con los miembros partes del cuerpo	Lesiones oculares graves, quemaduras, hemorragias, asfixias	27	II	91			Inspección de sitio. Programa de mantenimiento preventivo. Inspección de materiales al equipo. Inducción de seguridad. PPU, PGE					
		Tapa mal cerrada	Impacto de proyectiles o agujas biocombinadas con los miembros partes del cuerpo	Reacciones cutáneas, alergias, infecciones respiratorias, enfermedades e infecciones, biocombinación engañosa	27	II	91			Inducción de seguridad. Anti-agujas. Inspección de sitio. Inducción de seguridad. PPU, PGE					
		Rotoran funcionamiento	Contacto de manos con el rotor en funcionamiento	Heridas, quemaduras, fracturas, hemorragias	10	IM	91			Inspección de sitio. Programa de mantenimiento preventivo. Inspección de materiales al equipo. Inducción de seguridad. PPU, PGE					
		Ronra de material de vidrio	Impacto con esquirlas de vidrio o agujas biocombinadas con los miembros partes del cuerpo	Lesiones oculares graves, quemaduras, hemorragias, asfixias	27	II	91			Seguir la carga simultáneamente. Uso de guantes compatibles con el equipo. Inspección de sitio. Inspección de materiales y materiales. Inducción de seguridad					
		Base del equipo / superficie inestable	Inestabilidad del equipo, caída del equipo, generación de electricidad	Asfixias, golpes, fracturas, quemaduras, hemorragias, lesiones oculares	27	II	91			Indicador de nivel en equipo	Inspección de sitio. Inducción de seguridad. PPU, PGE				
		Cables y/o interruptores en mal estado	Electrocución	quemaduras, lesiones por electrificación, asfixias, paro cardíaco, paro respiratorio, muerte	10	IM	91				Inspección de sitio. Inspección de materiales y sistemas eléctricos. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA. Brigada de emergencia				
		Generación de chispas eléctricas	Arreglo de incendios, incendios, explosiones	quemaduras, asfixias, lesiones secundarias, muerte	24	IM	91			Evitar habilidad en el ambiente. Mantener Intufo					
		Contacto con puntas energizadas	Electrocución	lesiones por electrificación, quemaduras, shock, fibrilación ventricular, asfixias, paro cardíaco, paro respiratorio, muerte	24	IM	91				Inducción de seguridad. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal de la UNCA. Brigada de primeros auxilios				
		Manipulación con manos o pies mojadas	Electrocución	quemaduras, lesiones por electrificación, asfixias, paro cardíaco, paro respiratorio, muerte	10	IM	91				Inspección de sitio. Inducción de seguridad. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA. Brigada de emergencia				
		Materiales roto o en mal estado	Contacto con superficies punzocortantes	lesiones cutáneas, hemorragias, infecciones, quemaduras, asfixias	10	IM	91				Inspección de sitio. Inspección de materiales y sistemas eléctricos. U. Inducción de seguridad				
		Base o superficie inestable	Caida del equipo, derrame de material caliente, derrame de sustancias peligrosas	quemaduras, lesiones cutáneas, intoxicaciones	20	IM	91				Inspección de sitio. Verificar estabilidad del equipo previo al uso. Inducción de seguridad				
		Cocinita callena	Contacto directo con superficies calientes	quemaduras, lesiones cutáneas	10	IM	91				Observación preventiva. Inducción de seguridad. Procedimiento de uso de Cocinita (PPU)				
		Derrame de líquidos calientes	Contacto con líquidos a altas temperaturas	quemaduras, lesiones cutáneas	20	IM	91				Inducción de seguridad. PPU, PGE. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de primeros auxilios. Brigada de emergencia				
		Frascos de reactivos (alta presión)	Impacto de vapores calientes, asfixias o manos, generación de proyectiles de paredes o sustancias	quemaduras, asfixias, lesiones cutáneas, golpes	10	IM	91				Inspección de sitio. Inducción de seguridad. Charlas sobre MATPF (de ser el caso). No correr herméticamente				
		Generación de vapores calientes	quemaduras, lesiones cutáneas	quemaduras, lesiones cutáneas	10	IM	91				Inducción de seguridad. No exponer rostro ni otras partes del cuerpo a línea de vapor				

La impresión o copia adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"



OTRO DOCUMENTO

PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA

CÓDIGO: PDI-OD-95  
 FECHA: Marzo - 2022  
 VERSIÓN: 01  
 PÁGINA: 72 DE 75



*Jan*

11	Uso de balanza de precisión	Colocación de equipo sobre superficie	Equipo de silbido, sifón con desulfuración, irregularidades	lectura de datos incorrectos o ilegibles	Estés trabajos, ansiedad, trastornos metabólicos por atrazo en actividades laborales y/o académicas.	14	NO	SI			Biblioteca de sibil	Procedimiento de uso de balanzas. Inspección periódica de equipos. Buzones para reportar irregularidades.	5	TO	NO	
		Exclusión de equipo	Generación de chispas eléctricas	Amago de incendios, incendios, explosiones	quemaduras, asfixias, lesiones secundarias, muerte	24	III	SI				Extintor habilitado e intercambiable. Mantas húmedas	Inspección de extintores. Buzones para reportar irregularidades. Procedimiento de manejo de Sustancias Peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de emergencia. Capacitación en primeros auxilios. Botiquín de emergencia.	6	TO	NO
			Contacto con pinchos e irrigadores	electrocución	lesiones por electrocución, quemaduras, shock, fibrilación ventricular, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	24	III	SI					Inducción de seguridad. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA. Brigada de primeros auxilios	8	TO	NO
			Manipulación con manos o pies mojados	electrocución	quemaduras, lesiones por electrocución, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	18	III	SI					Inspección de tierra. Inducción de seguridad. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA. Brigada de emergencia	8	TO	NO
	Pesaje de muestras	placas de vidrio de l equipo en mal estado / material en mal estado	Contacto con sifones o otros puzoocortantes	lesiones cutáneas, hemorragias, infecciones cutáneas, y otros.	16	NO	SI				Sustitución de materiales rotos o en mal estado	Inspección de extintores. Inspección de periódica del equipo. Programa de mantenimiento preventivo. Inspección de periódica de instrumentos y materiales. Inducción de seguridad.	EP Básico. Uso de EPP (guantes) de requerir.	8	TO	NO
		Equipo inestable / superficie inestable	Caida de equipo	Golpes, lesiones, quemaduras, atricciones.	16	NO	SI					Inspección de tierra. Inspección de periódica de equipos. Procedimiento para uso de antiocho. Capacitación en el uso del equipo. Inducción de seguridad	8	TO	NO	
		Posturas inadecuadas	Sobre esfuerzo lumbar	lumbalgia	18	III	SI					alfombra de oficina de mesario y bancos. Buzones de reposo.	Buzones para reportar irregularidades. Cambios posturales. Pautas activas. Charlas 5 min. sobre ergonomía	4	T	NO
	12	Uso de microscopio / estereoscopia	Cables, enchufes y/o conexiones en mal estado	electrocución	quemaduras, lesiones por electrocución, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	16	NO	SI					Inspección de tierra. Inducción de seguridad. Inspección de mantenimiento y sistemas eléctricos. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en Sustancias Peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de emergencia	4	T	NO
				Generación de chispas eléctricas	Contacto con cables, incendios	quemaduras, lesiones, golpes, muerte	20	III	SI				Extintor habilitado e intercambiable. Mantas húmedas	Inspección de extintores. Buzones para reportar irregularidades. Procedimiento de manejo de Sustancias Peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de emergencia. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA. Brigada de emergencia	6	TO
			Manos o pies mojados	electrocución	quemaduras, lesiones por electrocución, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	16	NO	SI					Inducción de seguridad. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA. Brigada de primeros auxilios	4	T	NO
Contacto con pinchos e irrigadores			electrocución	lesiones por electrocución, quemaduras, shock, fibrilación ventricular, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	16	NO	SI					Inducción de seguridad. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación en primeros auxilios a personal UNCA. Brigada de primeros auxilios	4	T	NO	
Observación microscópica			Inestabilidad lumínica	Sobreexposición a la luz / Poca intensidad de luz	Fatiga visual. Mostrando síntomas: dolor, escozor, sequedad, lagrimeo, de blefar, y molestias en los ojos, visión borrosa.	18	III	SI				Regulador de intensidad de luz	Inducción de seguridad. Inspección periódica de equipos. PPU. Charlas de seguridad.	5	TO	NO
		posturas inadecuadas	Movimientos repetitivos, posturas forzadas, malas posturas, posturas	Fatiga muscular. Migrañas. Contracturas	18	III	SI				alfombra de oficina de mesario y bancos de reposo.	Buzones para reportar irregularidades. Cambios posturales. Pautas activas. Charlas sobre ergonomía	5	TO	NO	
		Uso de lentes y lentes	Contacto con sifones puzoocortantes	Corte, lesiones, hemorragias	16	NO	SI				Sustitución de materiales rotos o en mal estado	Inspección de extintores. Inspección de periódica de instrumentos y materiales. Inducción de seguridad.	5	TO	NO	
preparación de muestras		Fil de distribución de agua	Contacto con sifones puzoocortantes	Corte, lesiones, hemorragias	18	III	SI					No exposición de los ojos al filo de la tijera, al área de acción. Inducción de seguridad. Charlas de 5 minutos sobre seguridad, corte y distribución.	5	TO	NO	
		Materia biológica	Exposición y/o contacto con material biológico	Reacciones cutáneas, alergias, ascofisis respiratorias, enfermedades infecciosas, biocontaminación en general	20	III	SI					Inducción de seguridad. Información sobre agentes biocontaminantes en ambientes de clase. Charlas 5 min. de bioseguridad.	EP Básico. EPP específico (guantes, tapabocas, lentes de seguridad, protección facial) según corresponda.	5	TO	NO
13		Uso de pHmetro de mesa / pHmetro de bolsillo	Medición de pH en muestras.	Contacto con sustancias corrosivas, irritantes		18	III	SI					Conocer los MSDS y acciones. Charlas 5 min sobre peligros químicos. PPU	EP Básico. EPP específico (guantes de nitrilo, lentes de seguridad, protección facial) según corresponda.	4	T
	Lavado de electrodos		Limpieza inadecuada	Contacto con pinchos, otros, con sustancias corrosivas, irritantes.	Alergias, quemaduras, dermatitis.	9	NO	SI					Conocer los MSDS y acciones. Charlas 5 min sobre peligros químicos. PPU	4	T	NO

La impresión o copia adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"







**OTRO DOCUMENTO**

**PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGIA**



CÓDIGO: PDI-OD-95  
 FECHA: Marzo - 2022  
 VERSIÓN: 01  
 PÁGINA: 74 DE 75






*Jan 2022*




















18	Uso del sistema de gas	Abrir el sistema de gas.	Apretar de sistema de gas no autorizadas	Incendio, explosión, deflagración	Quemaduras, asfixias, lesiones secundarias, muerte	30	II	SI		Puerta con candado	Restringir ingreso a personal		4	T	NO
			Fuga de gas	Incendio, explosión, deflagración	Quemaduras, asfixias, lesiones secundarias, muerte	30	II	SI		Extintor habilitado e el ambiente. Mantas húmedas. Sistema antiescape	Inspecciones diarias. Procedimiento de manejo de Situaciones Peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de emergencias. Capacitación a primeros auxilios. Botiquín de emergencia.		8	TO	NO
		Prestar atención al nivel del sistema de gas.	Mantener inflamable cerca	Combustión de material inflamable con fuego, incendio, explosión. Explosiones	Quemaduras mayores a tercer grado. Asfixias.	30	II	SI		Extintor habilitado e el ambiente. Mantas húmedas. Sistemas de alarmas contra incendios.	Evitar material inflamable a menos de 2 metros. Indicaciones de seguridad. Inspecciones diarias. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de emergencias.		4	T	NO
19	Uso de escritorio de melamina	Utilización de escritorio	Fuego ocasionado por sillas	Combustión de otros de partes de lote tipo, o ropa, con fuego.	Quemaduras.	18	III	SI		Extintor habilitado e el ambiente. Mantas húmedas.	Evitar apoyar partes de lote tipo directamente a la llama. No utilizar ropas textiles inflamables.	Epp básico.	8	TO	NO
			Instabilidad del mueble	Caida de mueble	Ablusiones, golpes, hematomas, aplastamientos	14	MO	SI			Inspecciones periódicas a ambientes y equipos. Superficies estables		5	TO	NO
			Superficies punzocortantes	Combustión con los cortantes o astillas	Cortes, lesiones cutáneas	14	MO	SI			Inspecciones periódicas a equipos y ambientes. Mantenimiento preventivo		4	T	NO
20	Uso de armarios y/o estantes	Utilización de armarios o estantes	Alfara de escritorio y espacio inadecuados	Exposición de datos incorrectos o hexáctos	Fatiga muscular. Migrañas. Contracturas	14	MO	SI		Escritorio con plataforma en altura adecuada	Evitar posturas inadecuadas. Cambios posturales. Pausas activas. Círculos sobre ergonomía		4	T	NO
			Instabilidad del mueble	Caida de mueble	Ablusiones, golpes, hematomas, aplastamientos	16	MO	SI		Andar armarios	Inspecciones periódicas a ambientes y equipos. Superficies estables		5	TO	NO
		Superficies punzocortantes	Combustión con los cortantes o astillas	Cortes, lesiones cutáneas	16	MO	SI			Inspecciones periódicas a equipos y ambientes. Mantenimiento preventivo		5	TO	NO	
21	Uso de computadora de escritorio / laptop	Ejecutar y/o cargar de equipo	Colocación objetos	Sobrecarga del armario	Cortes y hematomas	16	MO	SI			Procedimiento escrito de trabajo seguro		5	TO	NO
			Cables y/o interruptores en mal estado	electrocución	Quemaduras, lesiones por electrificación, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	18	III	SI			Inspección diaria. Indicación de seguridad. Inspección de instalaciones y sistemas e equipos. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación a primeros auxilios a personal UNCA. Brigadas de emergencia.		6	TO	NO
			Generación de chispas eléctricas	Amago de incendios, incendios, explosiones	Quemaduras, asfixias, lesiones secundarias, muerte	20	III	SI		Extintor habilitado e el ambiente. Mantas húmedas. Sistemas de alarmas contra incendios.	Inspecciones diarias. Procedimiento de manejo de Situaciones Peligrosas. Plan de respuesta ante emergencias. Brigada de emergencias. Capacitación a primeros auxilios. Botiquín de emergencia.		6	TO	NO
		Utilización de equipo de cómputo	Mantención con manos o pies mojados	electrocución	Quemaduras, lesiones por electrificación, asfixias, paro cardiorrespiratorio, muerte	18	III	SI			Inspección diaria. Indicación de seguridad. Plan de respuesta ante emergencias. Capacitación a primeros auxilios a personal UNCA. Brigadas de emergencia.		6	TO	NO
			Postura inadecuada	Movimiento de cuello, posturas prolongadas, movilidad restringida.	Fatiga muscular. Migrañas. Contracturas	18	III	SI		Escritorio y silla adecuadas	Evitar malas posturas. Ambiente saludable de trabajo. Cambios posturales. Pausas activas. Círculos sobre ergonomía		6	TO	NO
			Uso prolongado de mouse	Movimientos repetitivos de mano, muñeca, brazo así como posturas prolongadas	Dolor de mano, muñeca, brazo, tendinitis y síndrome del túnel carpiano	9	MO	SI		Mouse ergonómico. Uso de palmoneers para muñeca	Pausas activas. Círculos sobre ergonomía		8	TO	NO
			Radiación ionizante prolongada	Sobreexposición prolongada a nivel de computadora	Fatiga visual, irritación y/o enrojecimiento de ojos, cataratas	18	III	SI			Pausas activas. Registrar nivel excesivo de computado. Círculos sobre ergonomía		6	TO	NO
23	Bancos de madera y silla ejecutiva	Utilización de silla	Silla o banco en mal estado	Rotura de silla o banco, y caída	Golpes, hematomas, contusiones	20	III	SI		Cambio de banco o silla	Mantenimiento preventivo, inspección de ambientes de trabajo		6	TO	NO
			Piso resbaladizo	Caida a nivel	Hematomas, heridas, traumatismos en cuello humano y muerte	16	MO	SI		Antideslizante	Inspecciones diarias. Inspecciones periódicas de equipos.		6	TO	NO
			Postura prolongada	Sobrecarga lumbar	Traumatismos Muscoesqueléticos	20	III	SI			Evitar malas posturas. Ambiente saludable de trabajo. Cambios posturales. Pausas activas. Círculos sobre ergonomía		6	TO	NO




	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-95		
		FECHA:	Marzo - 2022		
	<b>PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOLÓGIA</b>		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		<b>75 DE 75</b>

### Anexo Nº 6. MAPA DE RIESGOS

LEYENDA	
	ATENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO
	ATENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO
	ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO
	ATENCIÓN RIESGO DE GASES
	ATENCIÓN RIESGO DE QUÍMICOS
	ATENCIÓN RIESGO DE CALOR
	ATENCIÓN RIESGO DE ALTA PRESIÓN
	ATENCIÓN RIESGO DE LASERES
	ATENCIÓN RIESGO DE TOXICIDAD
	ATENCIÓN RIESGO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES
	ATENCIÓN RIESGO DE EXPLOSIONES
	ATENCIÓN RIESGO DE INCENDIOS
	ATENCIÓN RIESGO DE CAÍDAS DE OBJETOS
	ATENCIÓN RIESGO DE RESBALOS
	PRIMEROS AUXILIOS
	EXTINTOR
	MANEJO DE AGUAS
	DEFECTOR DE MANOS
	PUERTAS DE EMERGENCIA

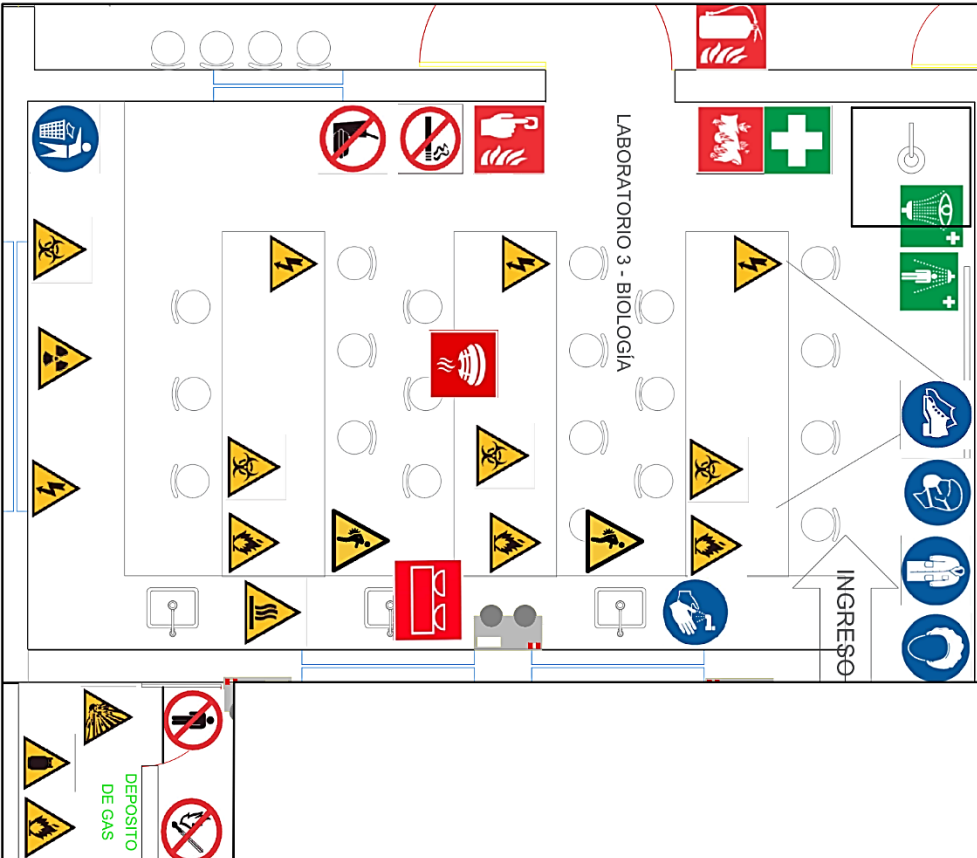

**PROYECTO:**  
MAPA DE RIESGO DEL LABORATORIO DE BIOLÓGIA Y BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

**UBICACIÓN:**  
SECTOR: HUAMACHICO  
DISTRITO: HUAMACHICO  
PROVINCIA: HUAMACHICO  
REGION: LA LIBERTAD

**PROFESIONAL RESPONSABLE:**  
UEI - UNCA

**ESPECIALIDAD:**

**DIBUJO:**

**ESCALA:**  
ESPECÍFICO

**FECHA:**  
OCTUBRE - 2021

**PLANO Nº:**  
MR-07